



# 精度測定検査表

*Examination for precision list*

メーカー	ファナック	年式	2003年製	管理番号	P006711
型式	$\alpha$ -T14iD	測定者	野辺沼	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

## 主軸振れ


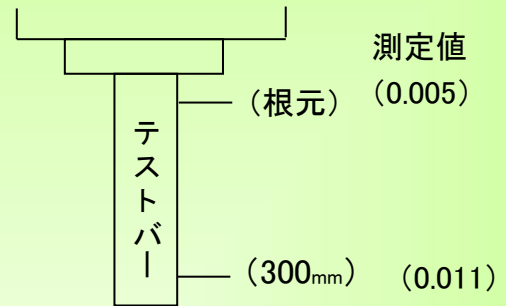
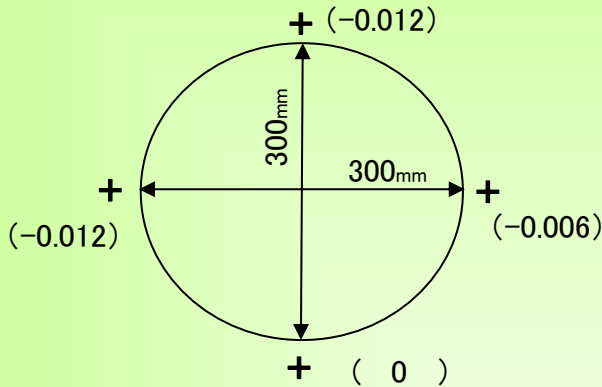


## 直角度

【Y Z】測定値 (0.022)

【X Z】測定値 (0.002)

【X Y】測定値 (0.008)

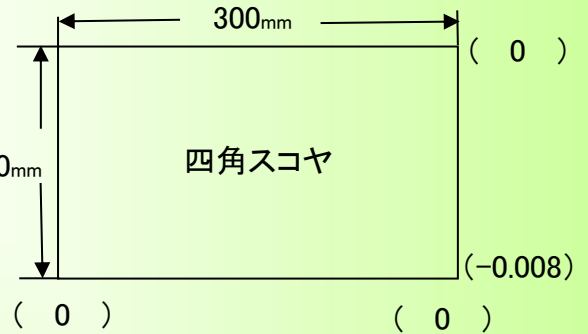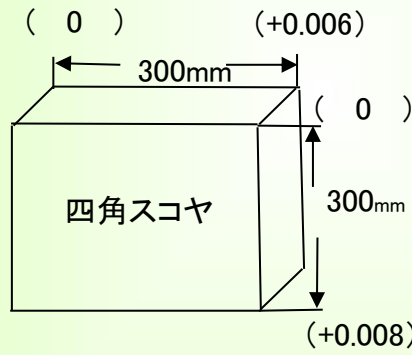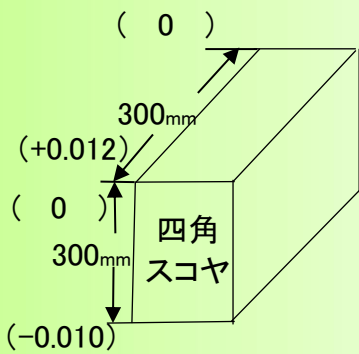

## 上面精度

※テーブルサイズ 650 × 400

