精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	牧野フライス製作所	年式	1992年製	管理番号	P006427
型式	FNC106-A40	測定者	奥澤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

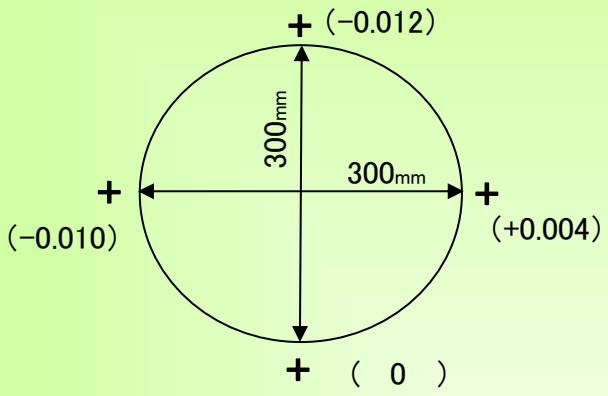

主軸振れ

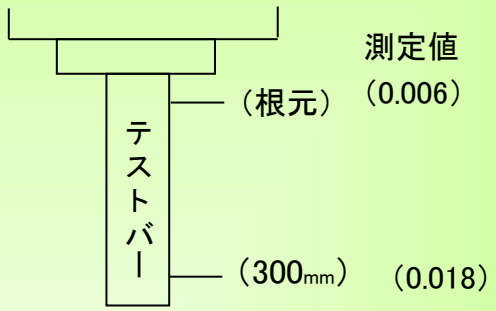

直角度

【Y Z】測定値 (0.010)

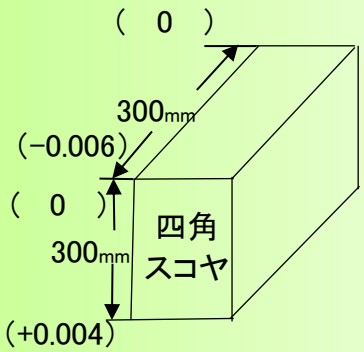

【X Z】測定値 (0.016)

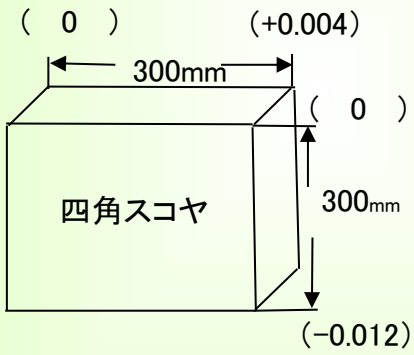

【X Y】測定値 (0.020)

上面精度
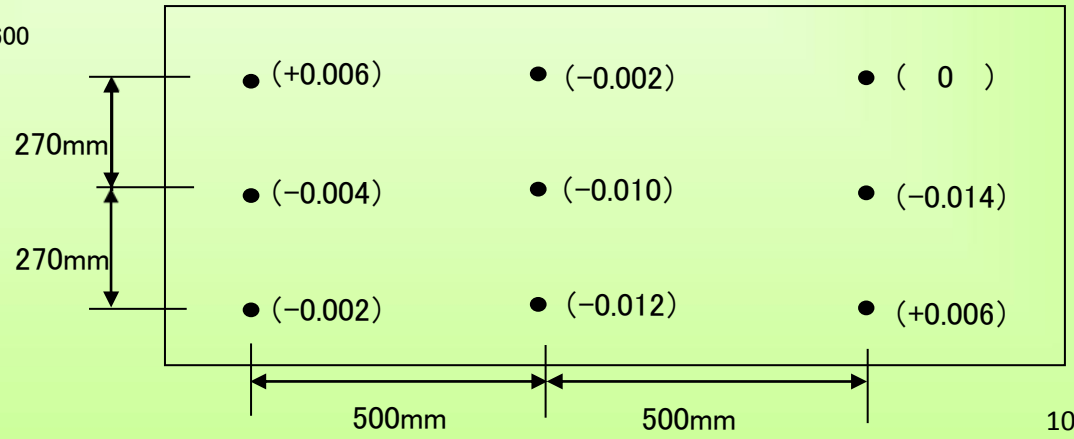
※テーブルサイズ 1400×600