



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2013年製	管理番号	P006855
型式	GENOS M560-V	測定者	金子	アシスタント	竜輝

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ


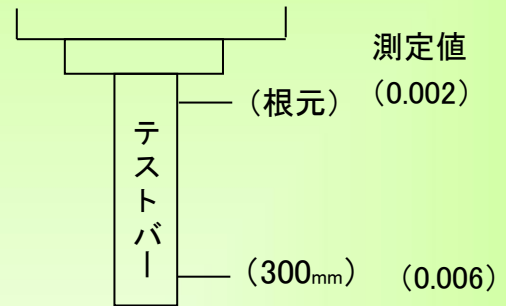
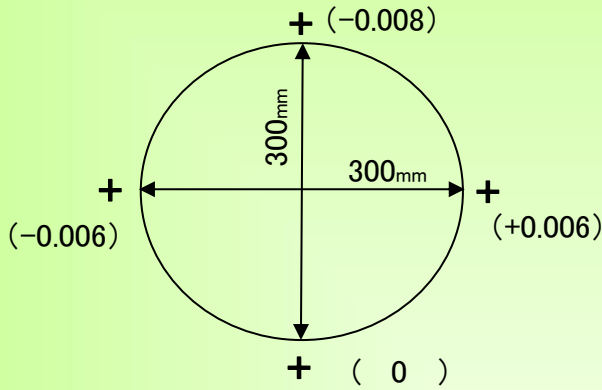


直角度

【Y Z】測定値 (0.004)

【X Z】測定値 (0.006)

【X Y】測定値 (0.002)

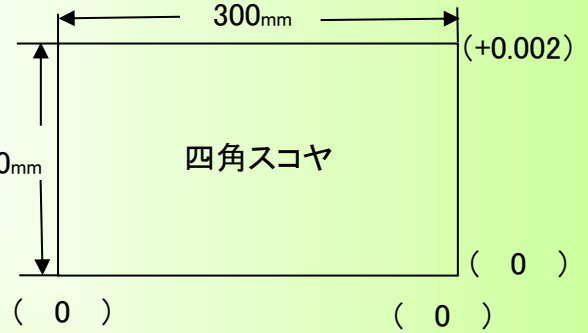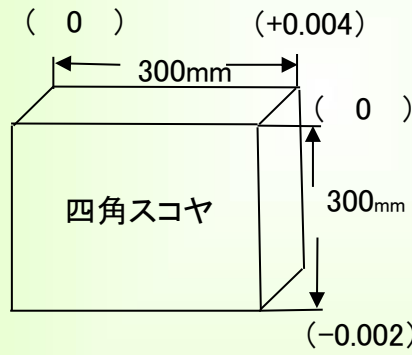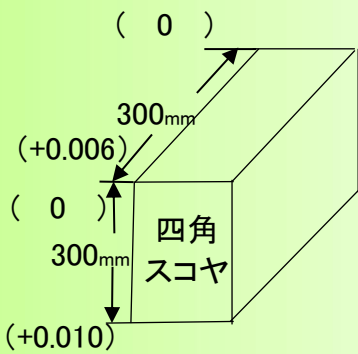

上面精度

※テーブルサイズ 1300×560

