



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2001年製	管理番号	P006836
型式	SV-403	測定者	金子	アシスタント	竜輝

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ


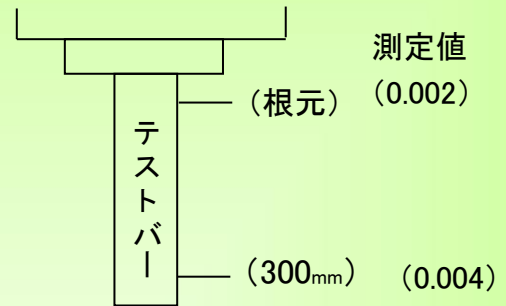
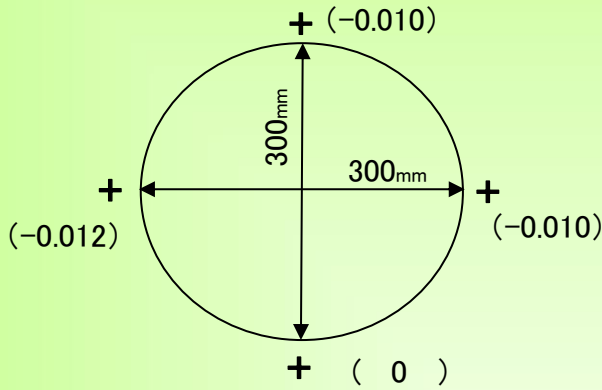


直角度

【Y Z】測定値 (0.006)

【X Z】測定値 (0.006)

【X Y】測定値 (0.004)

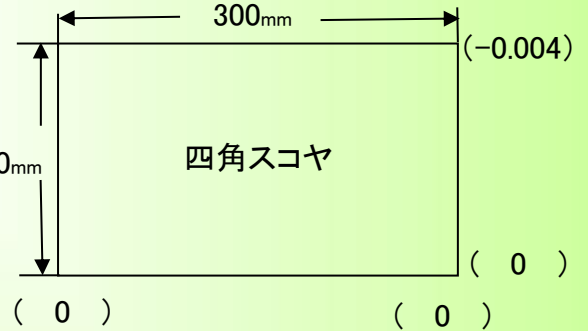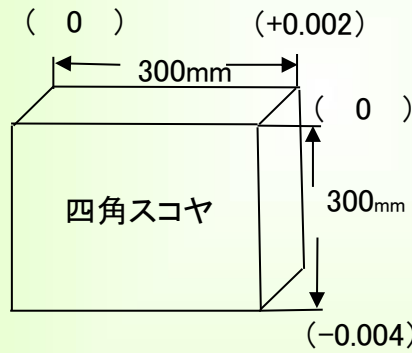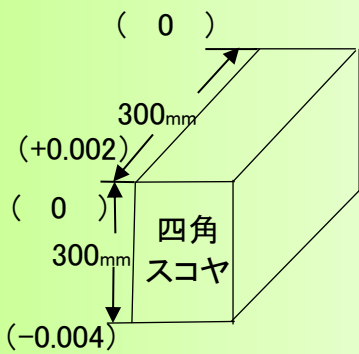

上面精度

※テーブルサイズ 900 × 500

