



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	1997年製	管理番号	P006744
型式	MX-45VAE	測定者	平野	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ


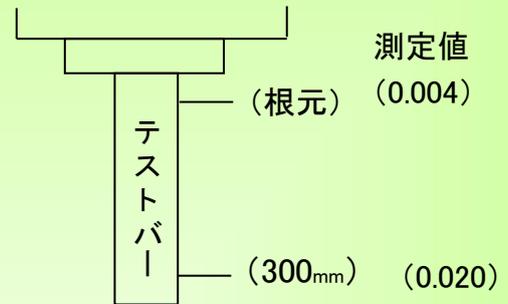
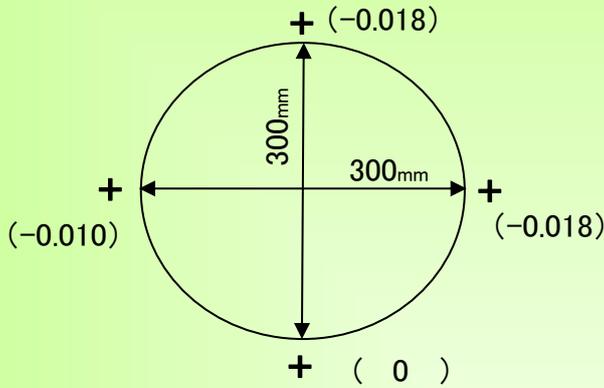


直角度

【Y Z】測定値 (0.030)

【X Z】測定値 (0.018)

【X Y】測定値 (0.006)

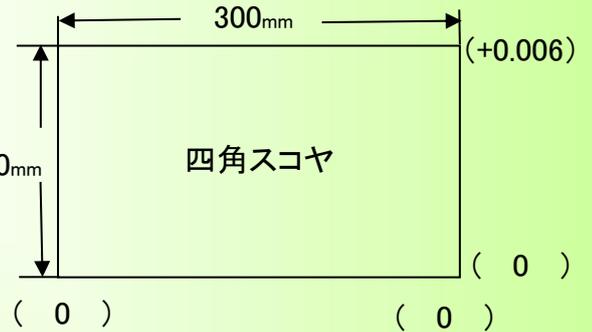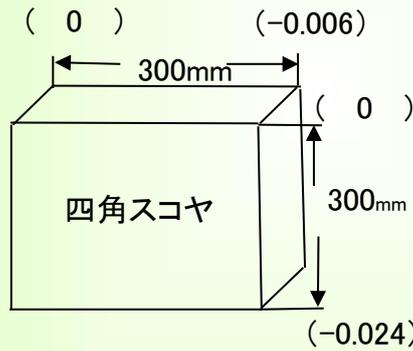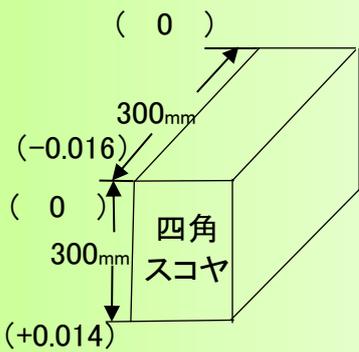

上面精度

※テーブルサイズ 1000×460

