


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	三井精機	年式	1997年製	管理番号	P006780
型式	HU50A	測定者	平野	アシスタント	

## Z軸方向の平行度

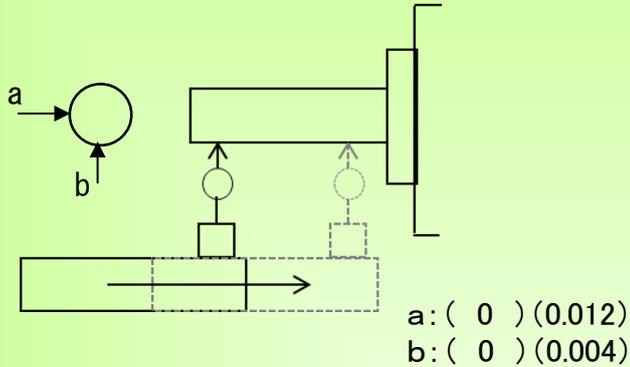

## 主軸振れ


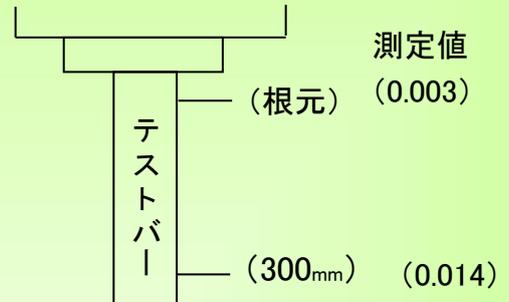


## 直角度

【XY】 測定値 (0.006)

【ZY】 測定値 (0.010)

【ZX】 測定値 (0.004)

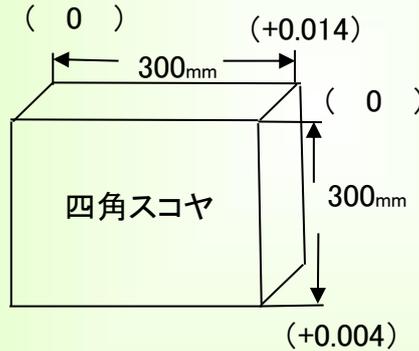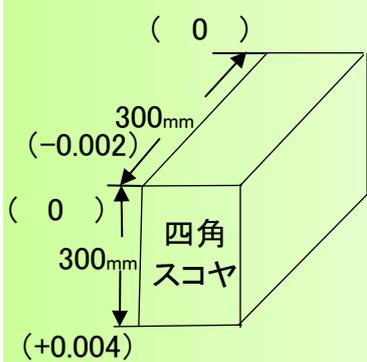

## 上面精度

テーブルサイズ: 500角

( ) → パレット1

