



# 精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	2004年製	管理番号	P006442
型式	VP400	測定者	金子	アシスタント	竜輝

## 振り回し(300ピッチ)

## 主軸振れ


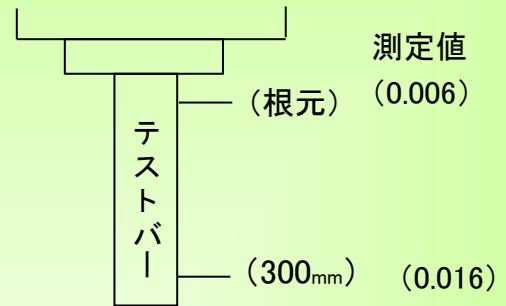
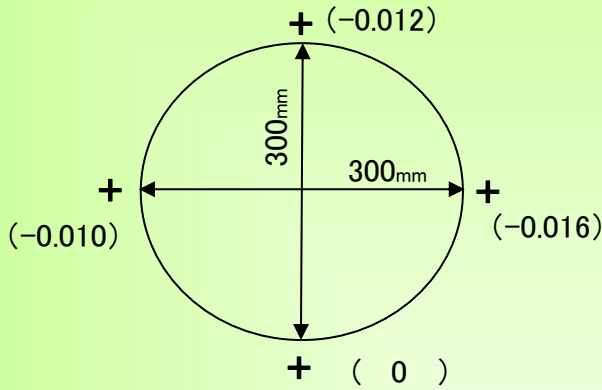


## 直角度

【Y Z】測定値 (0.004)

【X Z】測定値 (0.004)

【X Y】測定値 (0.004)

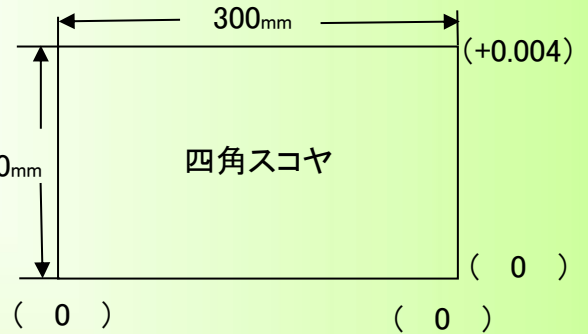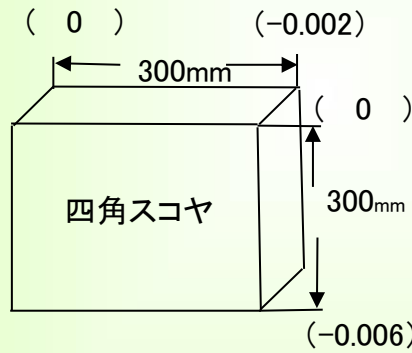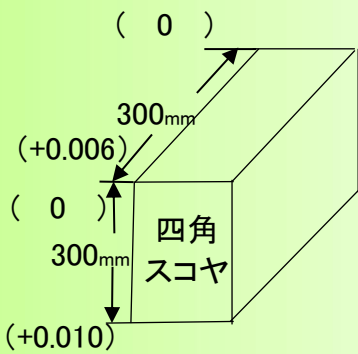

## 上面精度

※テーブルサイズ 900×410

