



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	2001年製	バーコード	P006895
型式	MILLAC-611VD	測定者	奥澤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ

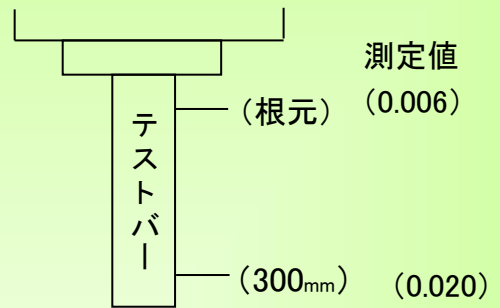
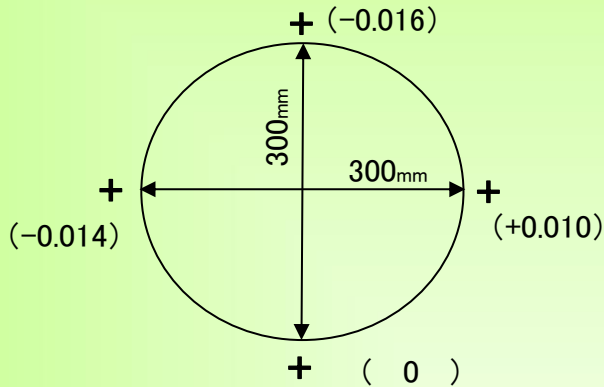


直角度

【YZ】測定値 (0.010)

【XZ】測定値 (0.010)

【XY】測定値 (0.012)

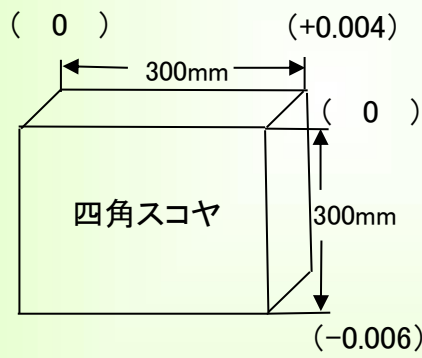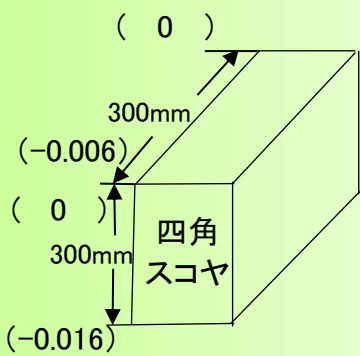

上面精度

※テーブルサイズ 1400×610

