



# 精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2003年製	バーコード	P006866
型式	α-T14iD	測定者	平野	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

## 主軸振れ


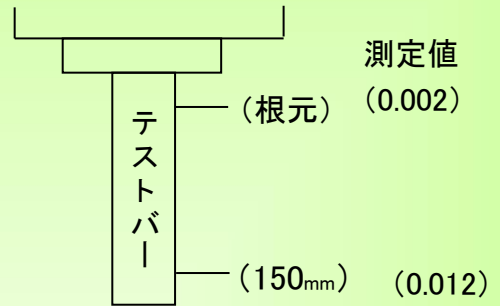
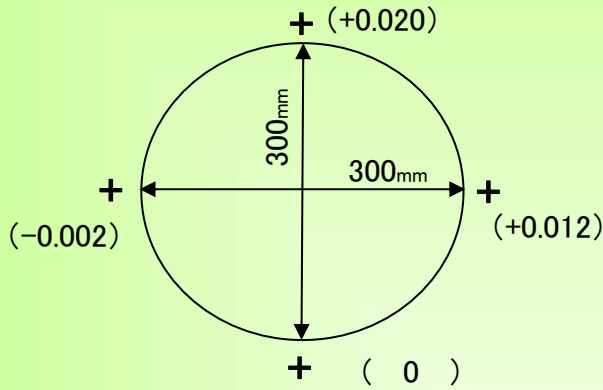


## 直角度

【YZ】 測定値 (0.020)

【XZ】 測定値 (0.014)

【XY】 測定値 (0.016)

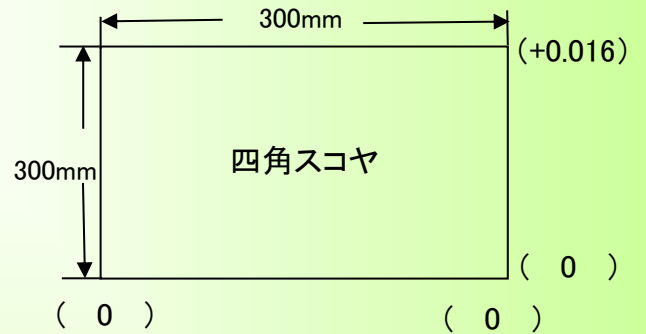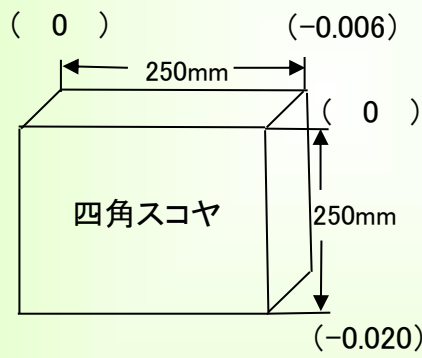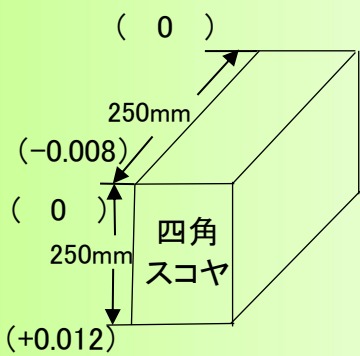

## 上面精度

※テーブルサイズ 650×400

