



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2001年製	バーコード	P006867
型式	α -T14iB	測定者	平野	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ


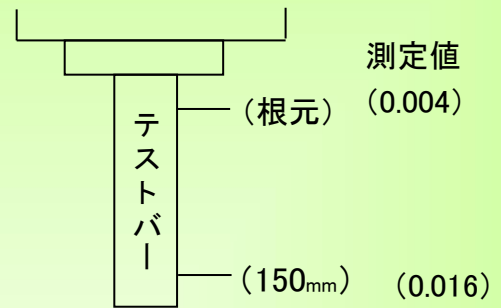
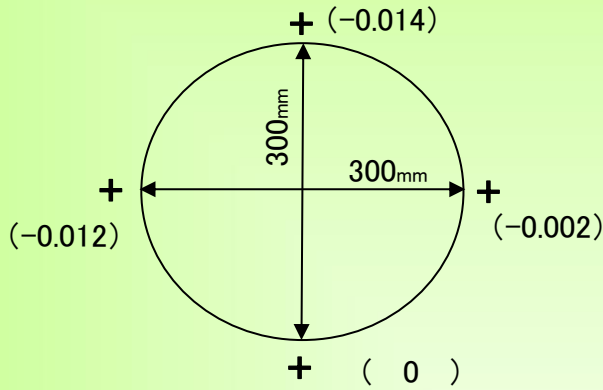


直角度

【YZ】測定値 (0.012)

【XZ】測定値 (0.010)

【XY】測定値 (0.004)

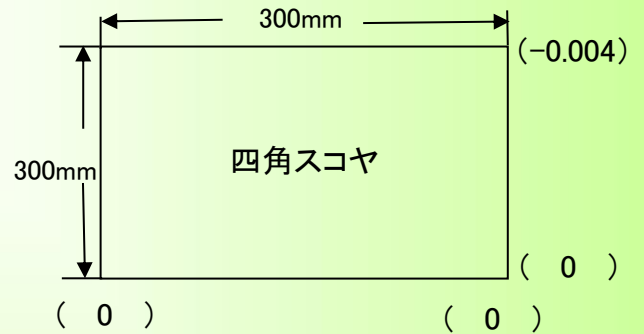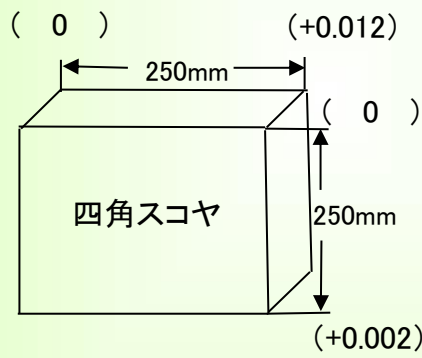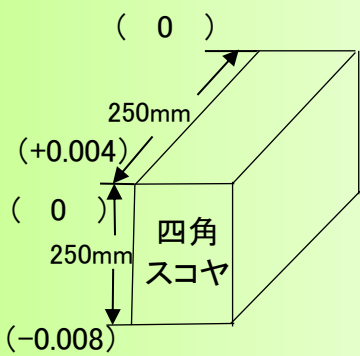

上面精度

※テーブルサイズ 650×400

