



# 精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	安田	年式	2005年製	バーコード	P006840
型式	YBM-640V3-PC	測定者	奥澤	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

## 主軸振れ

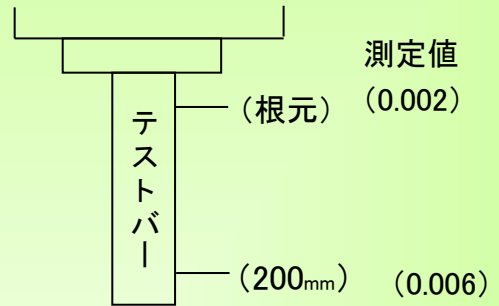
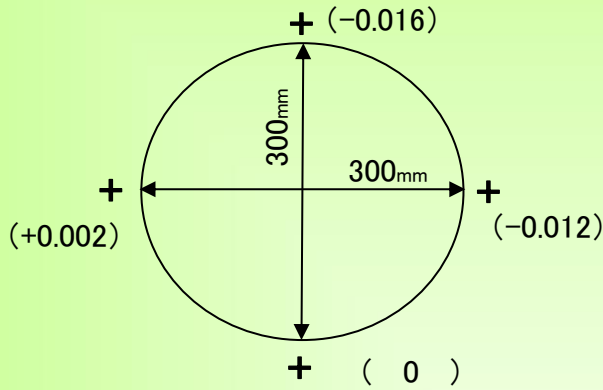


## 直角度

【YZ】測定値 (0.012)

【XZ】測定値 (0.004)

【XY】測定値 (0.002)

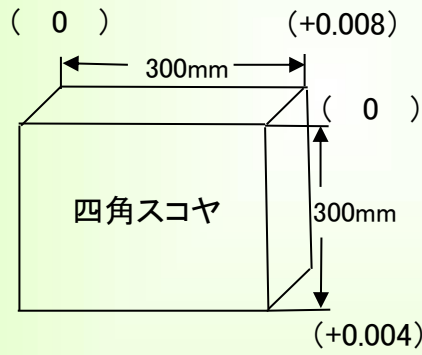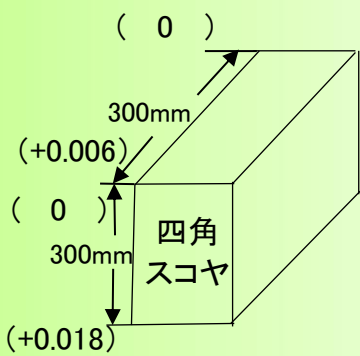

## 上面精度

※テーブルサイズ 600×400

