



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2008年製	バーコード	P006954
型式	DuraVartical5060	測定者	金子	アシスタント	竜輝

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ

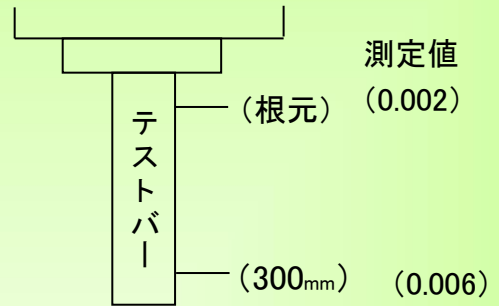
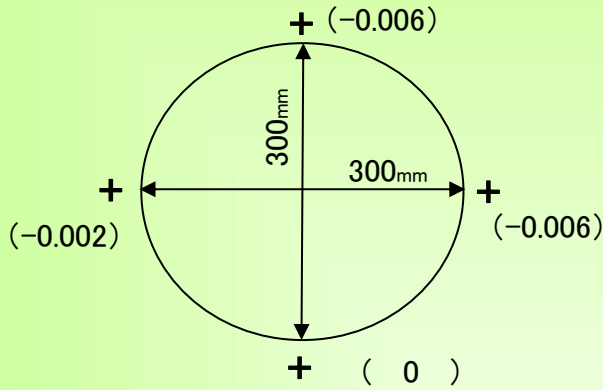


直角度

【YZ】 測定値 (0.006)

【XZ】 測定値 (0.018)

【XY】 測定値 (0.010)

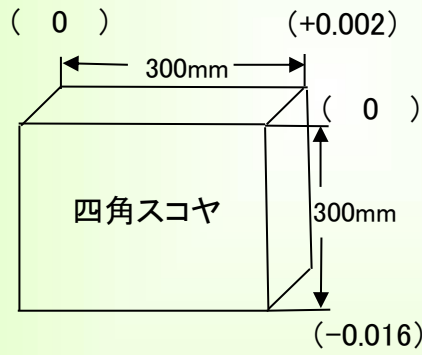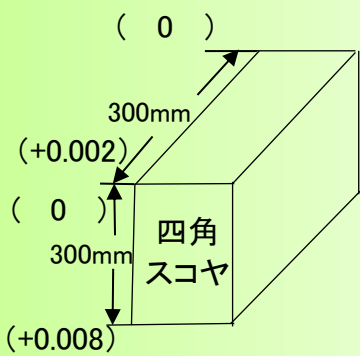

上面精度

※テーブルサイズ 900×600

