



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2000年製	バーコード	P006886
型式	GV-503	測定者	金子	アシスタント	竜輝

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ

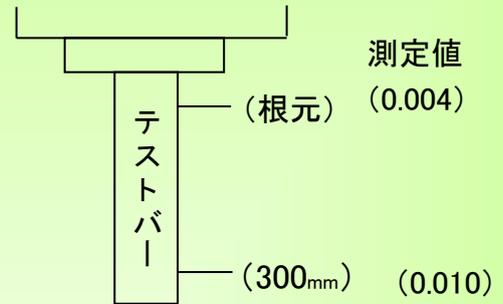
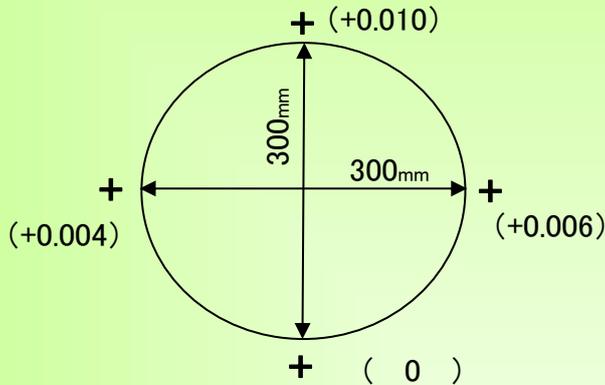


直角度

【YZ】 測定値 (0.004)

【XZ】 測定値 (0.010)

【XY】 測定値 (0.004)

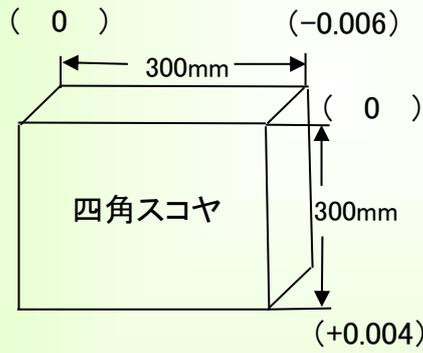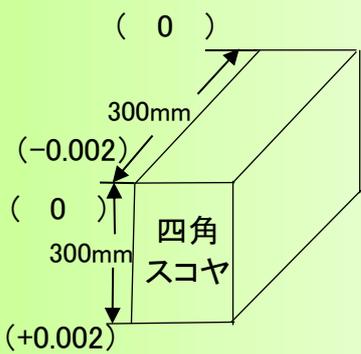

上面精度

※テーブルサイズ 750×550

パレットA()
パレットB[]

