



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2011年製	バーコード	P007050
型式	MB-46VA	測定者	金子	アシスタント	竜輝

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ


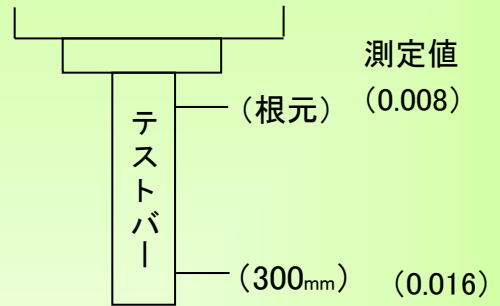
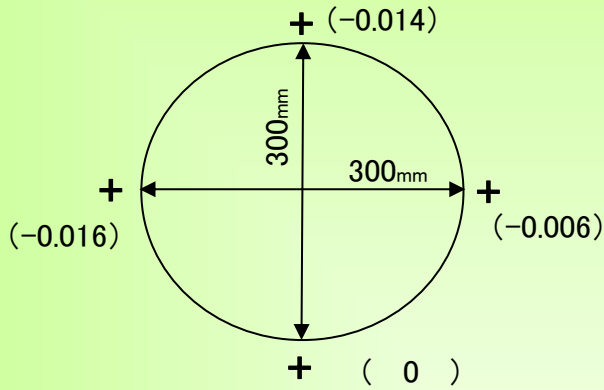


直角度

【YZ】測定値 (0.016)

【XZ】測定値 (0.012)

【XY】測定値 (0.004)

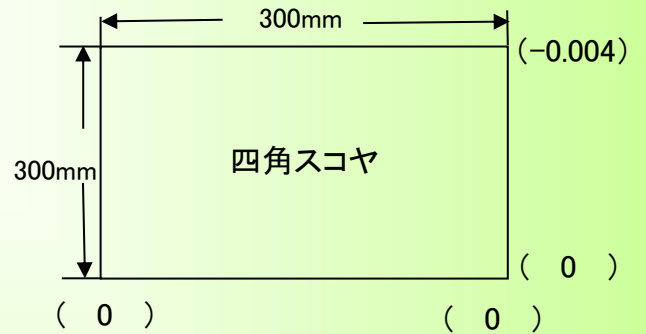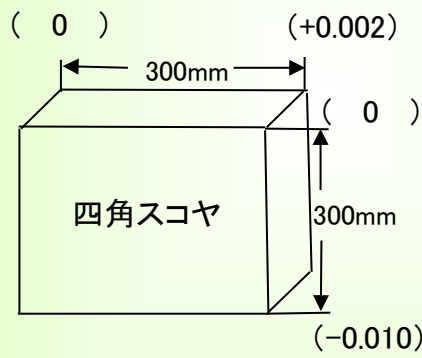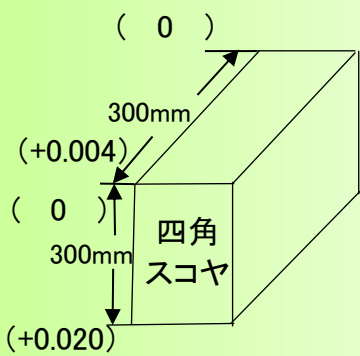

上面精度

※テーブルサイズ 760×460

