



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	牧野フライス製作所	年式	2000年製	バーコード	P007067
型式	V33	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ

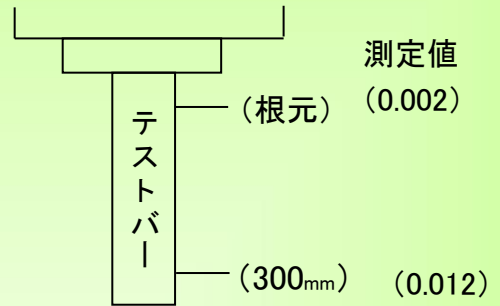
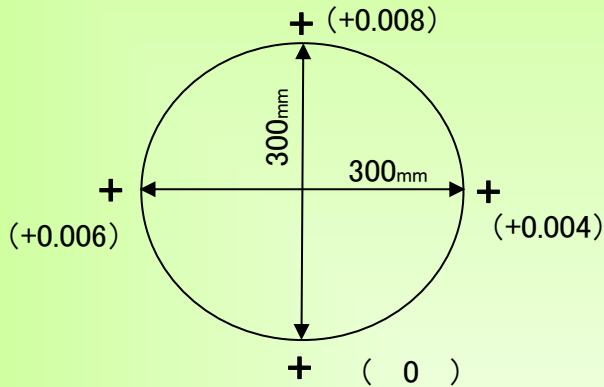


直角度

【YZ】測定値 (0.006)

【XZ】測定値 (0.008)

【XY】測定値 (0.010)

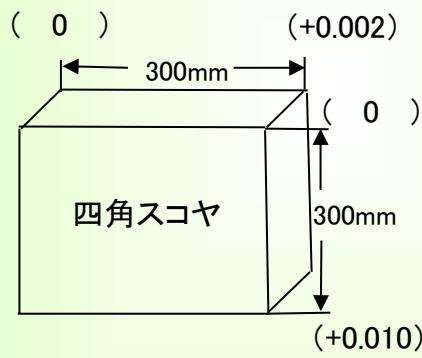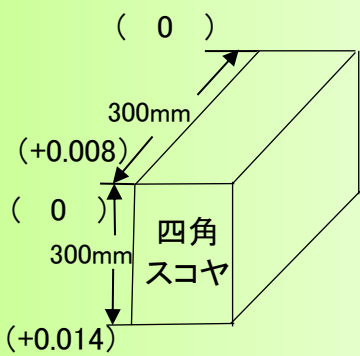

上面精度

※テーブルサイズ 750×400

