



# 精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2006年製	バーコード	P007117
型式	MILLAC-1052V	測定者	金子	アシスタント	竜輝

## 振り回し(300ピッチ)

## 主軸振れ


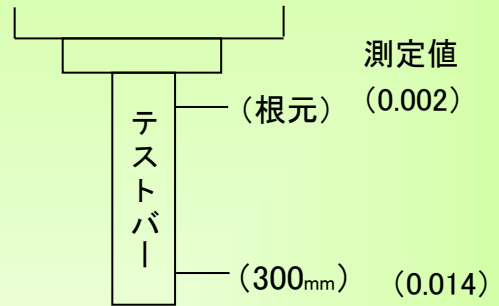
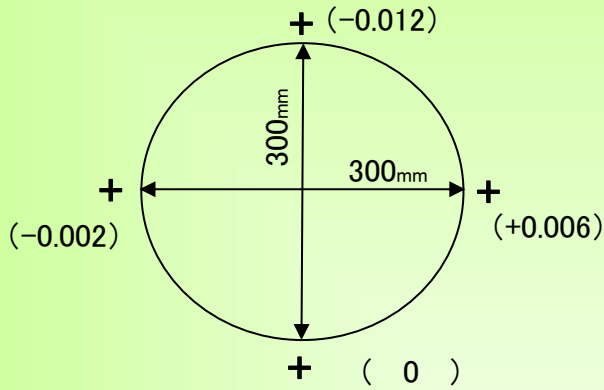


## 直角度

【YZ】測定値 (0.008)

【XZ】測定値 (0.010)

【XY】測定値 (0.004)

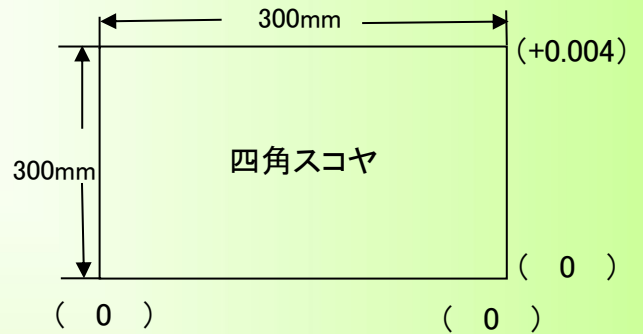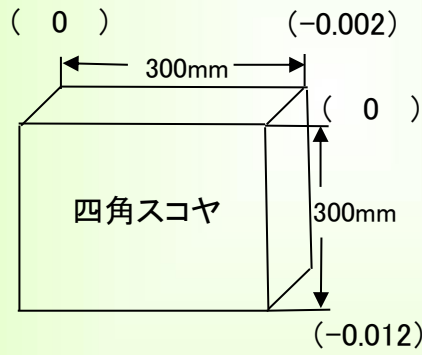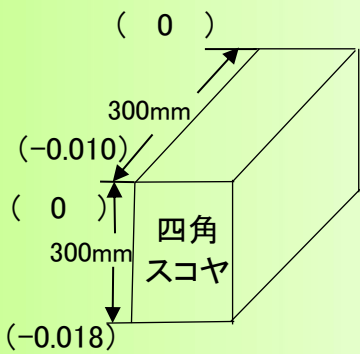

## 上面精度

※テーブルサイズ 3200×1050

