

精度測定検査表

Examination for precision list

測定日


2013. 6. 28

メーカー	ファナック	バーコード	P2315
型式	α-T14iF		


精度評価	コメント
A	0 ~ 0.02mm
B	0 ~ 0.03mm
C	0 ~ 0.04mm
D	0 ~ 0.05mm

精度良好です

振り回し(300ピッチ)

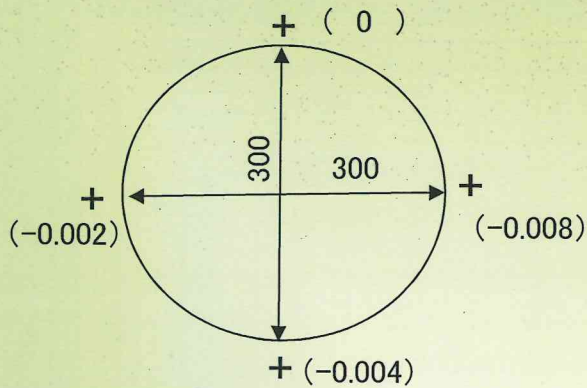


主軸振れ

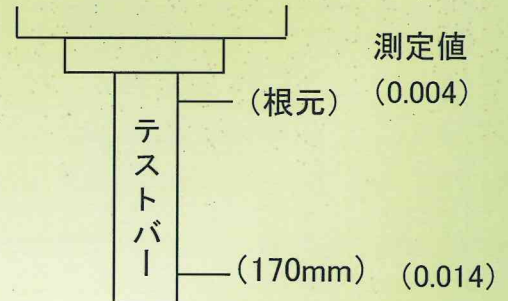


直角度


【YZ】

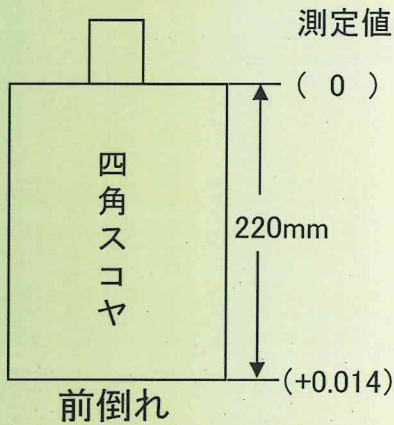

【XZ】

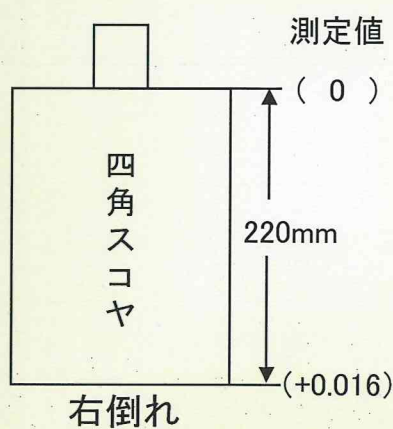

【XY】

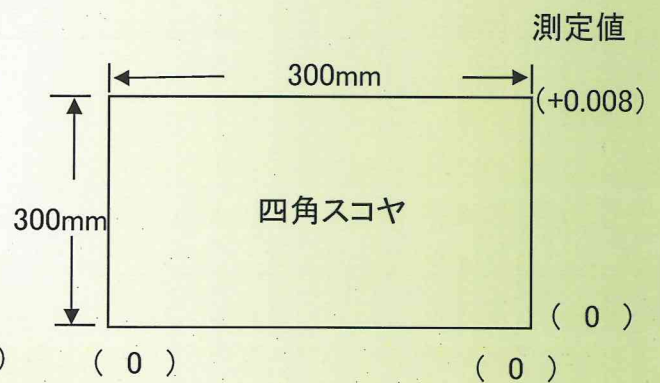

上面精度

