

精度測定検査表

Examination for precision list


測定日

2012.07.05


メーカー	安田	バーコード	P1673
型式	YBM-850V2		

精度評価		コメント
A	0 ~ 0.02mm	全ての項目で 精度良好です
B	0 ~ 0.03mm	
C	0 ~ 0.04mm	
D	0 ~ 0.05mm	

振り回し(300ピッチ)

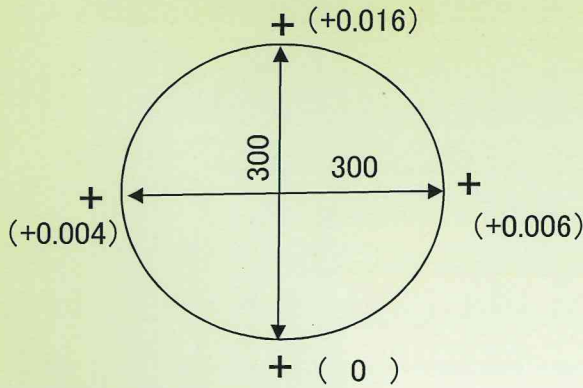


主軸振れ

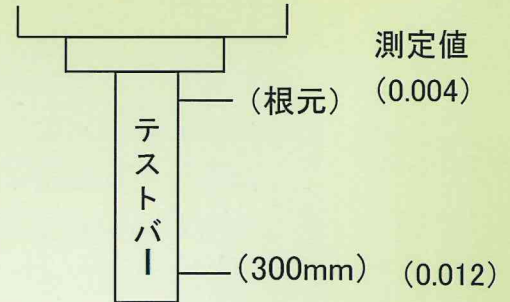


直角度

A/パレ

【Y Z】

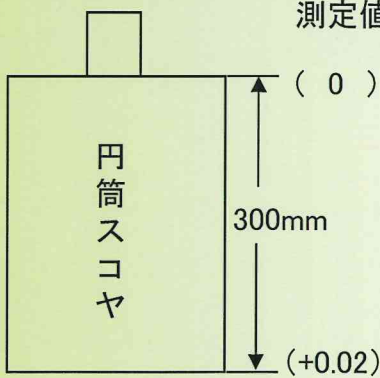

【X Z】

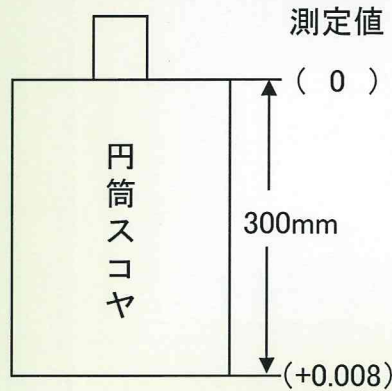

【X Y】



上面精度

