


精度測定検査表

Examination for precision list


精度評価		コメント
A	0 ~ 0.02mm	良好です。
B	0 ~ 0.03mm	
C	0 ~ 0.04mm	
D	0 ~ 0.05mm	

メーカー	ファナック	バーコード	P4490
型式	a-T14iA		

振り回し(300ピッチ)

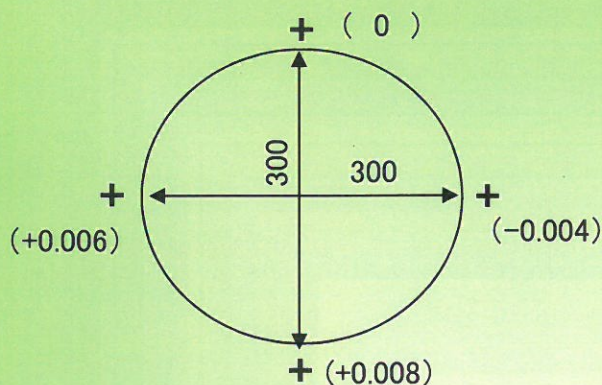

主軸振れ



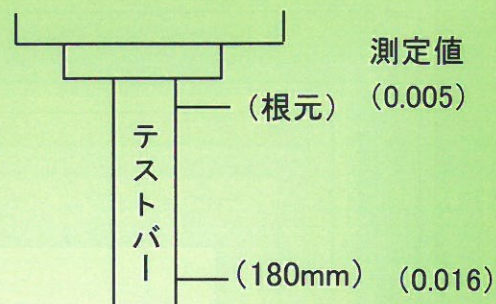


直角度

【Y Z】測定値 (0.008)

【X Z】測定値 (0.018)

【X Y】測定値 (0.016)

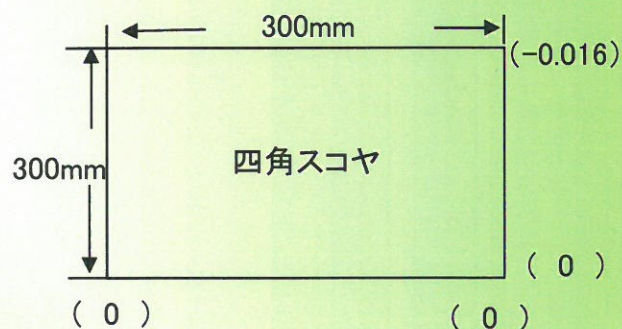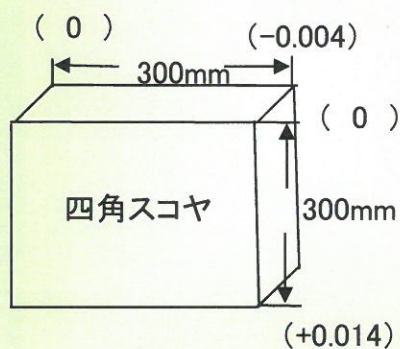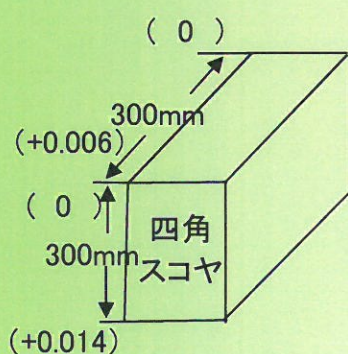

上面精度

