


# 精度測定検査表

Examination for precision list


|      |          |       |       |
|------|----------|-------|-------|
| メーカー | ヤマザキマザック | バーコード | P5006 |
| 型式   | VCN-410A |       |       |

| 精度評価 |            | コメント  |
|------|------------|-------|
| Ⓐ    | 0 ~ 0.02mm | 良好です。 |
| B    | 0 ~ 0.03mm |       |
| C    | 0 ~ 0.04mm |       |
| D    | 0 ~ 0.05mm |       |

## 振り回し(300ピッチ)

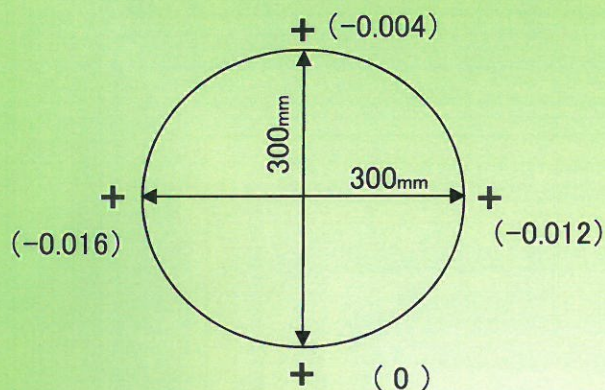

## 主軸振れ



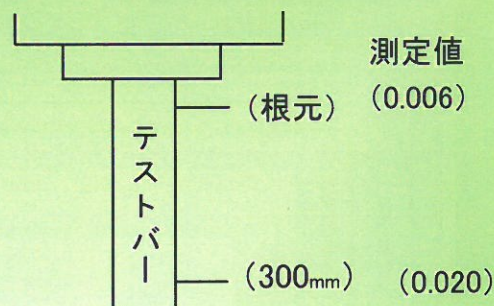


## 直角度

【Y Z】測定値 (0.008)

【X Z】測定値 (0.012)

【X Y】測定値 (0.014)

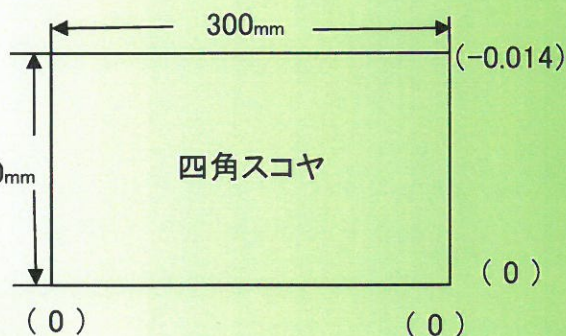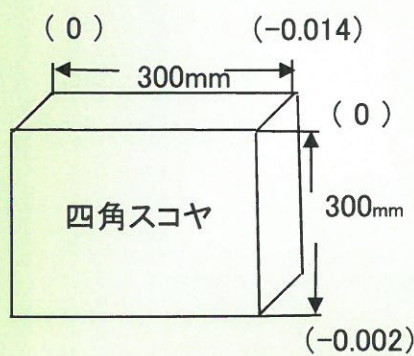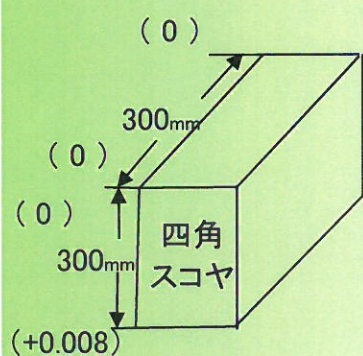

## 上面精度

| テーブル上面の平行度    |       |   |
|---------------|-------|---|
| 500以下         | 0.020 | ○ |
| 500を超え800以下   | 0.025 |   |
| 800を超え1250以下  | 0.030 |   |
| 1250を超え2000以下 | 0.040 |   |

