精度測定検査表

Examination for precision list

測定日　２０１２．０７．１９

メーカー	ファナック	バーコード	P1571
型式	α-T14iEL		

精度評価		コメント
(A)	0～0.02mm	極上品です
B	0～0.03mm	
C	0～0.04mm	
D	0～0.05mm	

振り回し(300ピッチ)

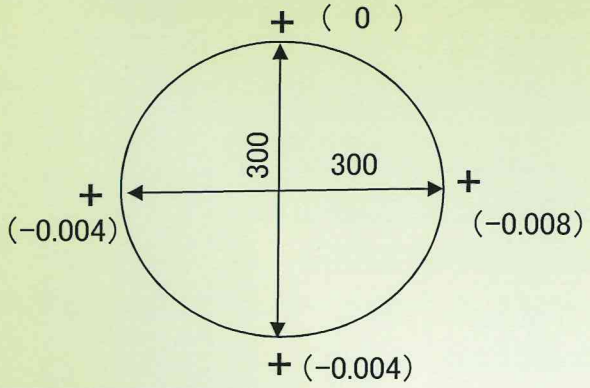

主軸振れ

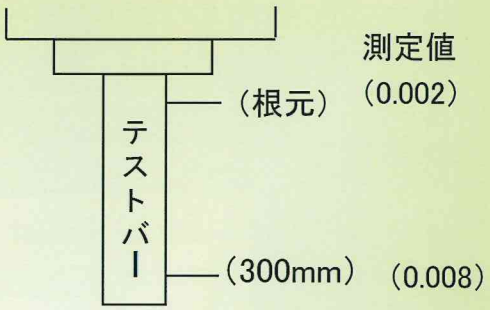

直角度

【Y Z】

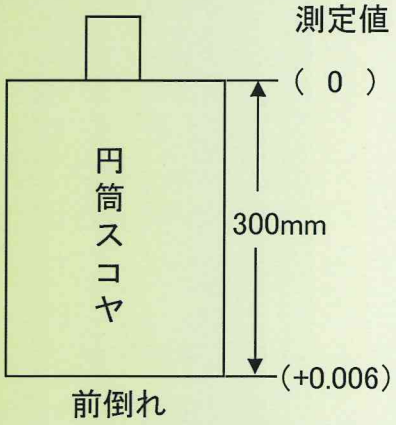

【X Z】

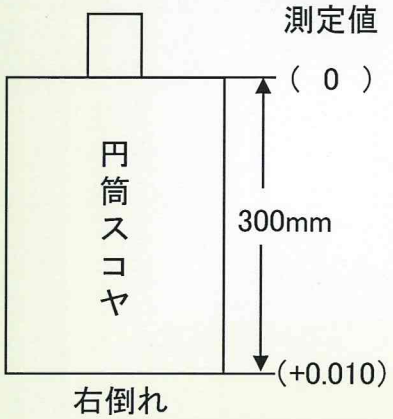

【X Y】

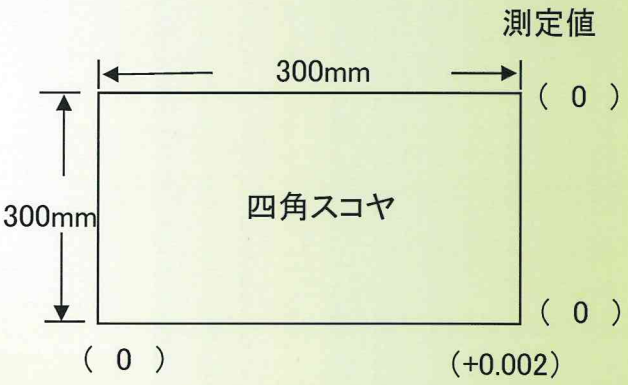

上面精度