


精度測定検査表

Examination for precision list


メーカー	オークマ	バーコード	P1677
型式	MA-400HA		

精度評価		コメント
A	0 ~ 0.02mm	全ての項目で かなり精度良好 です
B	0 ~ 0.03mm	
C	0 ~ 0.04mm	
D	0 ~ 0.05mm	

振り回し(300ピッチ)

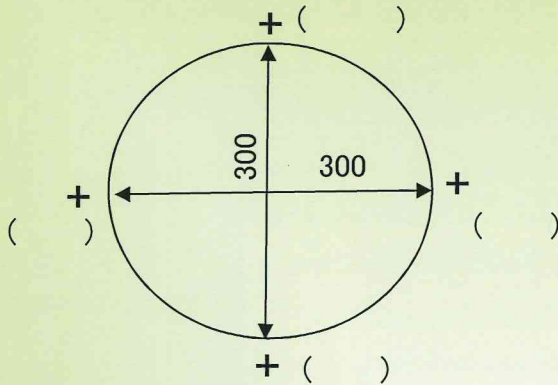


主軸振れ

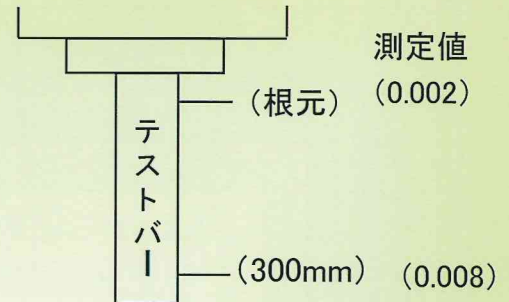


直角度

【YZ】

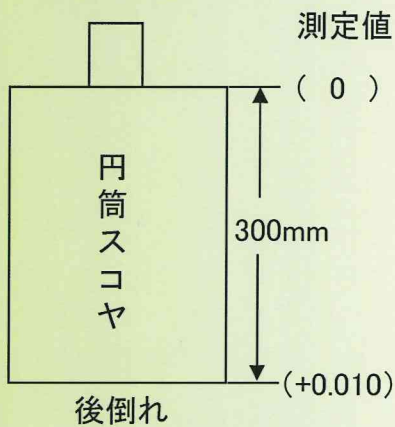

【XZ】

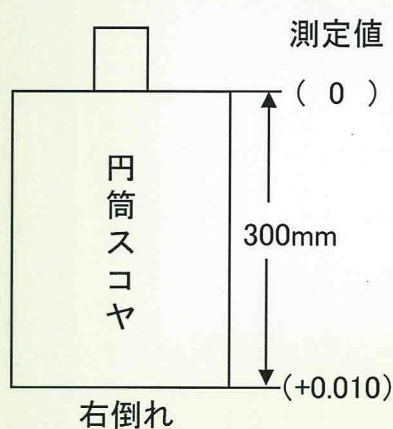

【YZ】



上面精度

(2パレット)[1パレット]

