


# 精度測定検査表

*Examination for precision list*


|      |     |       |       |
|------|-----|-------|-------|
| メーカー | OKK | バーコード | P5478 |
| 型式   | VM7 |       |       |

| 精度評価 |            | コメント   |
|------|------------|--------|
| Ⓐ    | 0 ~ 0.02mm | 精度良好です |
| B    | 0 ~ 0.03mm |        |
| C    | 0 ~ 0.04mm |        |
| D    | 0 ~ 0.05mm |        |

## 振り回し(300ピッチ)

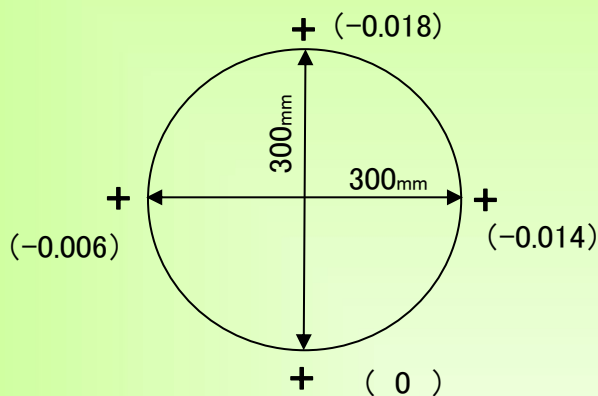

## 主軸振れ



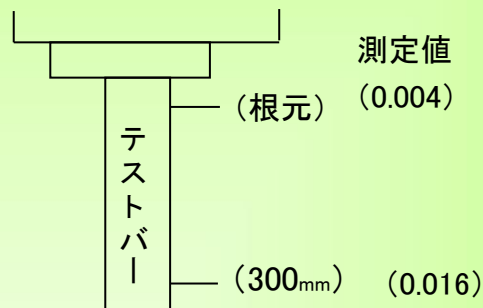


## 直角度

【Y Z】測定値 (-0.020)

【X Z】測定値 (+0.006)

【X Y】測定値 (0.006)

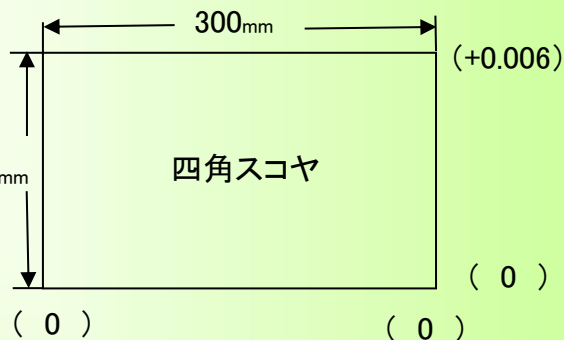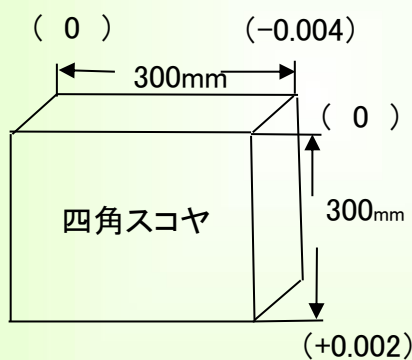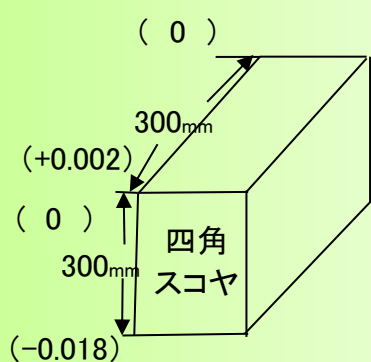

## 上面精度

※テーブルサイズ 740 × 1550

| テーブル上面の平行度    |       |
|---------------|-------|
| 500以下         | 0.020 |
| 500を超え800以下   | 0.025 |
| 800を超え1250以下  | 0.030 |
| 1250を超え2000以下 | 0.040 |

