



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2002年製	バーコード	P007044
型式	VS50	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ


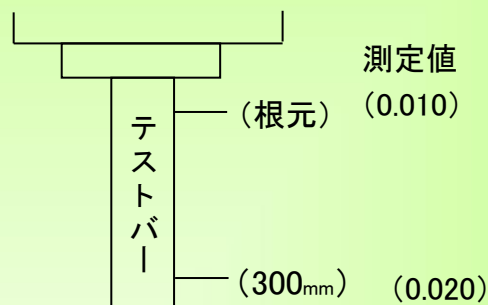
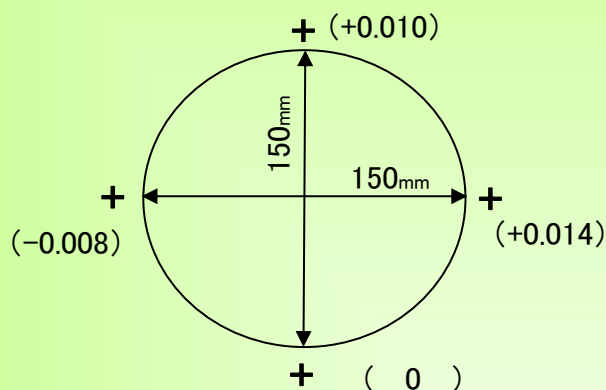


直角度

【YZ】測定値 (0.010)

【XZ】測定値 (0.024)

【X Y】測定値 (0.004)

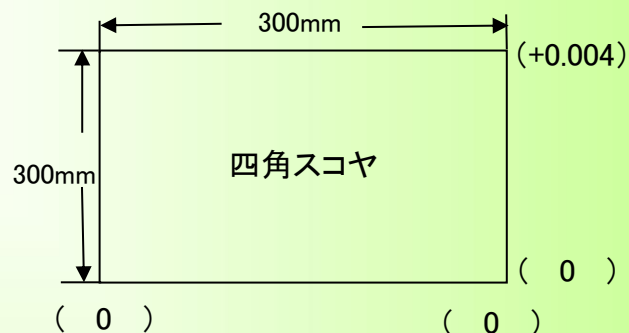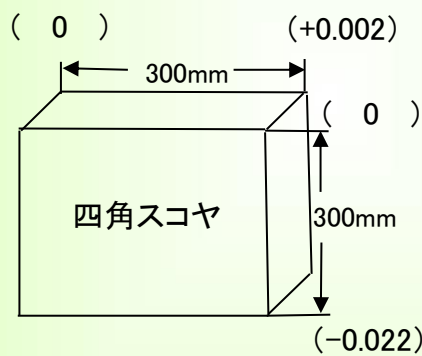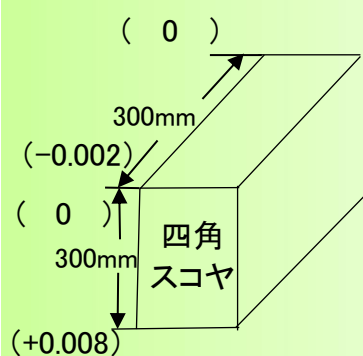

上面精度

※テーブルサイズ 1120×510

