

精度測定検査表



Examination for precision list

メーカー	ヤマザキマザック	年式	1997年製	バーコード	P007158
型式	MTV-515/40N	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ

※クランプ力
13.07kN

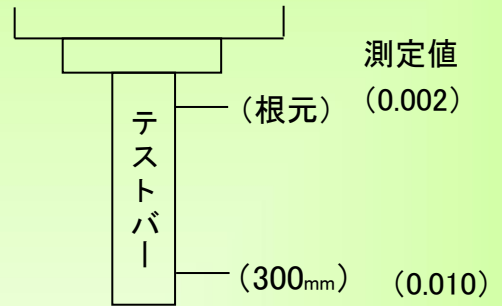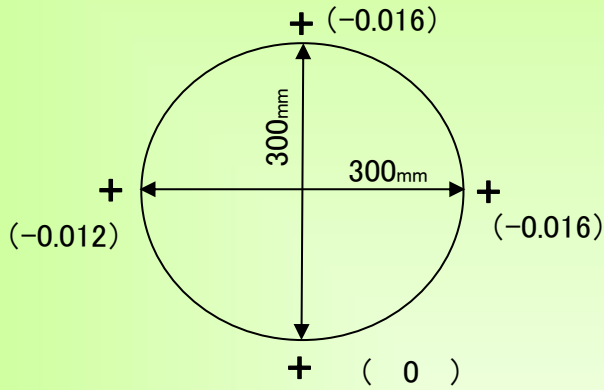

測定値

(根元) (0.002)




(300mm) (0.010)

直角度

【YZ】測定値 (0.008)

【XZ】測定値 (0.008)

【XY】測定値 (0.010)

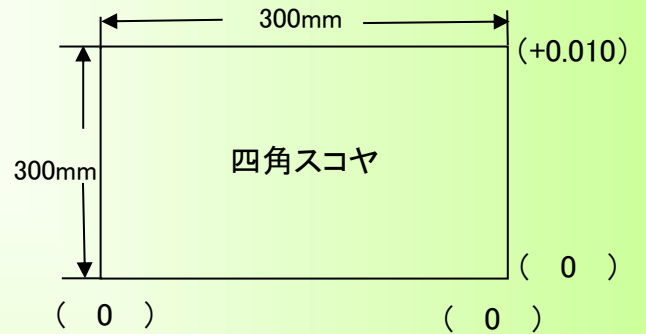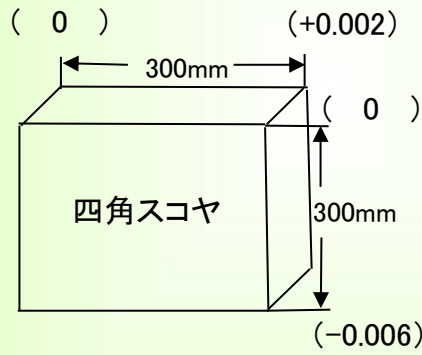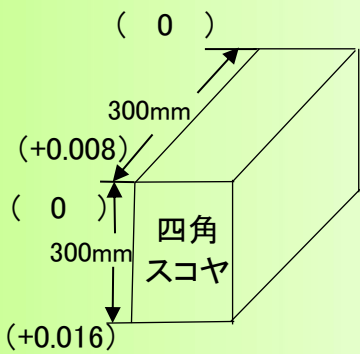

上面精度

※テーブルサイズ 1300×550

