



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	2003年製	バーコード	P006814
型式	VM5III	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ


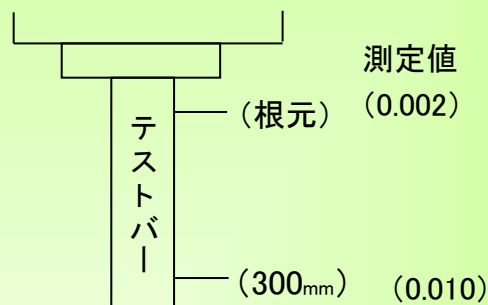
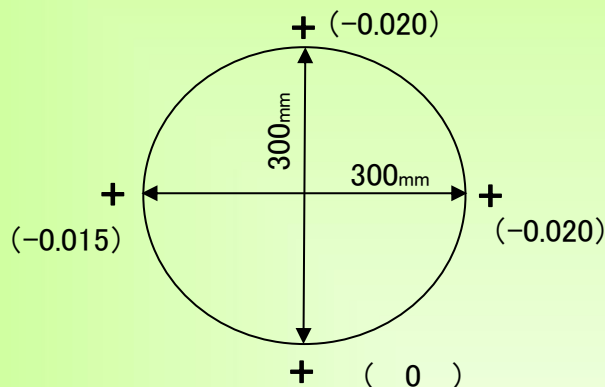


直角度

【YZ】測定値 (0.015)

【XZ】測定値 (0.015)

【XY】測定値 (0.012)

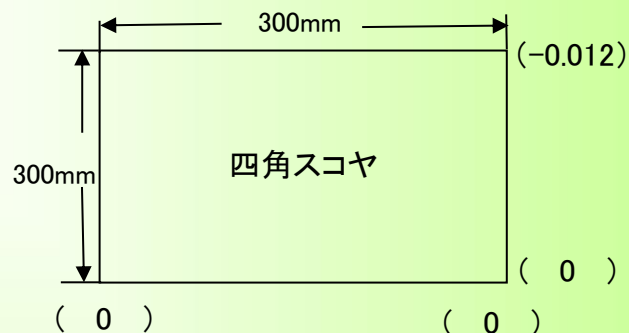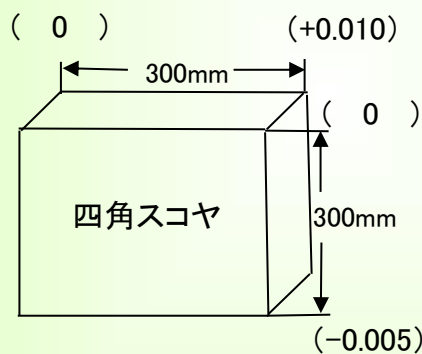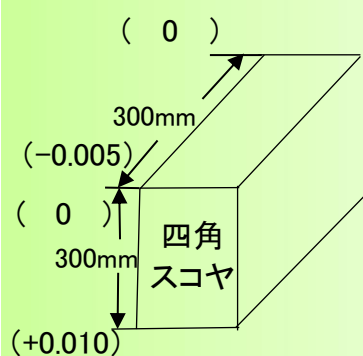

上面精度

※テーブルサイズ 1000×500

