

# 精度測定検査表



Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	2004年製	バーコード	P007183
型式	MILLAC-761V	測定者	金子	アシスタント	阿部

## 振り回し(300ピッチ)

## 主軸振れ

クランプ力  
17.43kN

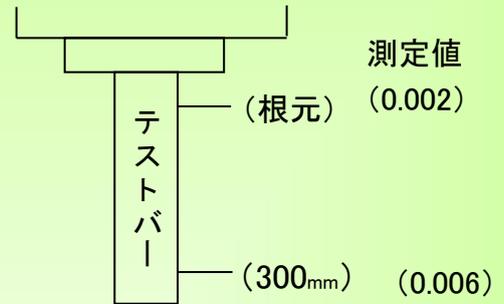
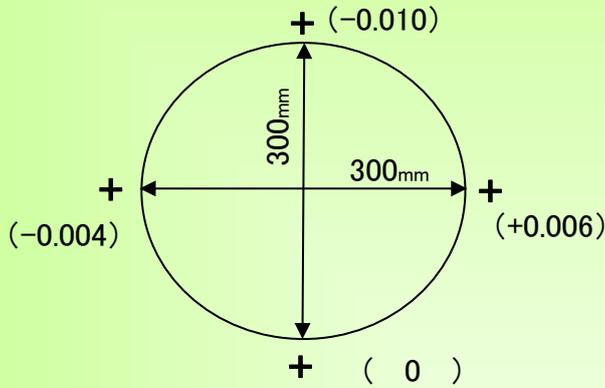


## 直角度

【YZ】測定値 (0.010)

【XZ】測定値 (0.010)

【XY】測定値 (0.006)

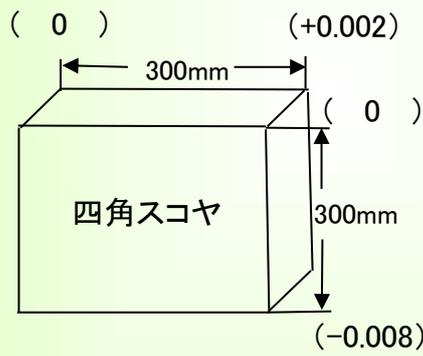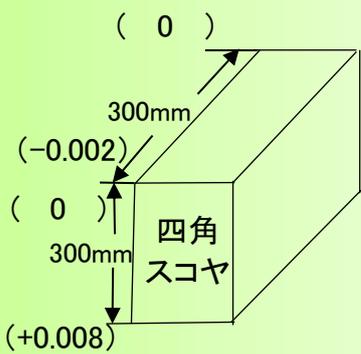

## 上面精度

※テーブルサイズ 1800×720

