



精度測定検査表

Examination for precision list

| | | | | | |
|------|-------------|-----|--------|--------|---------|
| メーカー | 大隈豊和 | 年式 | 2000年製 | バーコード | P007192 |
| 型式 | MILLAC-611V | 測定者 | 平野 | アシスタント | |

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ

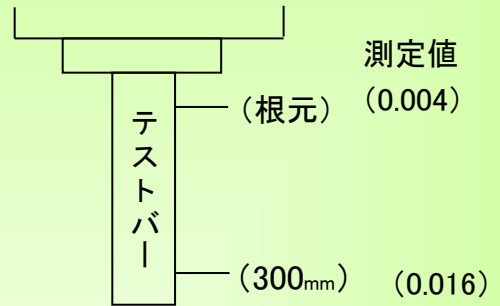
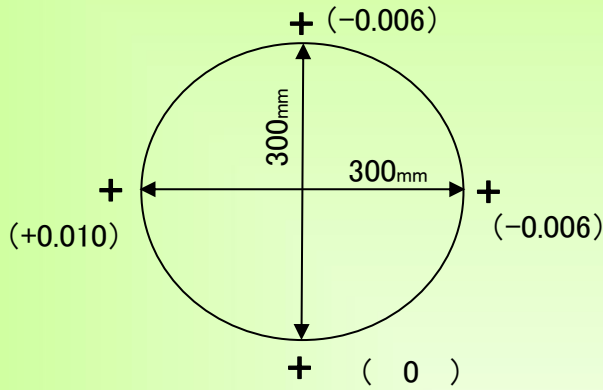


直角度

【YZ】測定値 (0.018)

【XZ】測定値 (0.016)

【XY】測定値 (0.010)

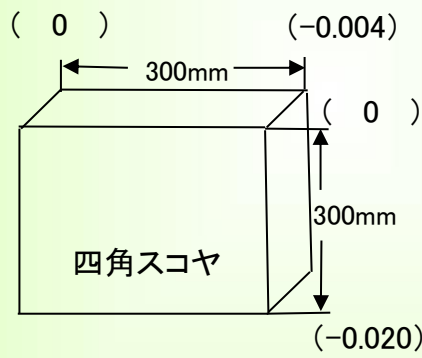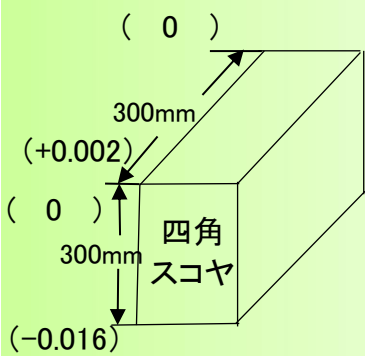

上面精度

※テーブルサイズ 1600×610

