



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	牧野フライス製作所	年式	1993年製	管理番号	G004661
型式	GN107-A30	測定者	金子	アシスタント	松山

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ

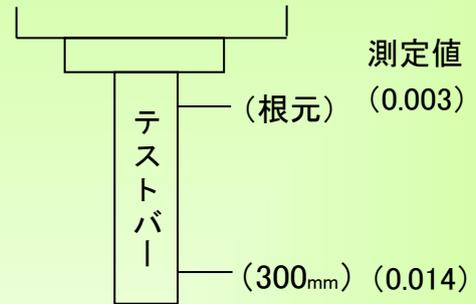
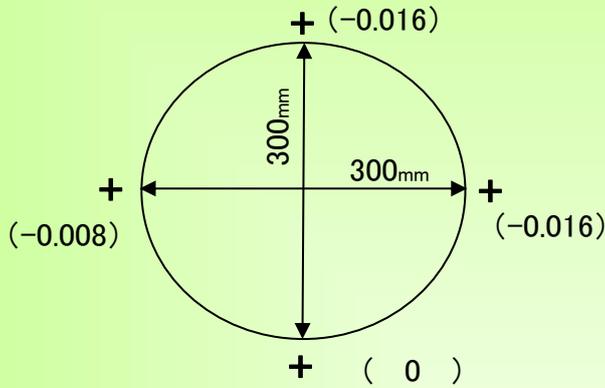


直角度

【YZ】測定値 (0.008)

【XZ】測定値 (0.010)

【XY】測定値 (0.010)

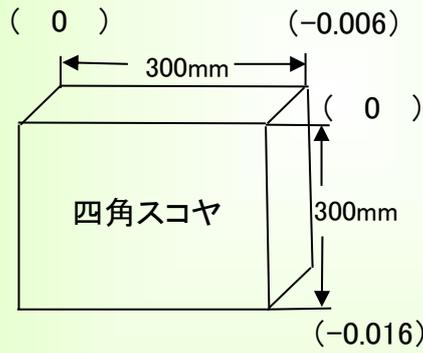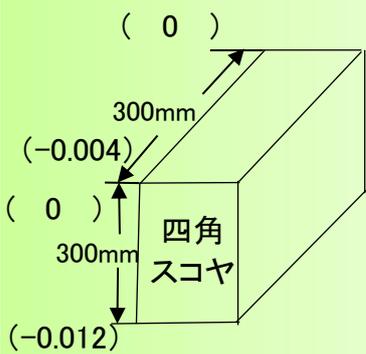

上面精度

※テーブルサイズ 1350×800

