



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2016年製	管理番号	P007199
型式	α -D14MiB5	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ


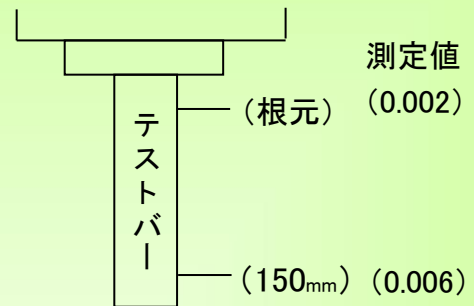
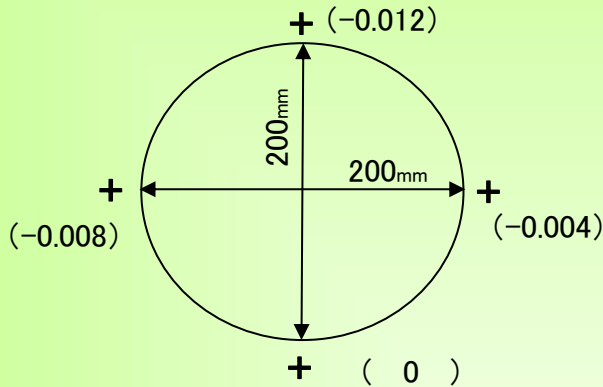


直角度

【YZ】測定値 (0.006)

【XZ】測定値 (0.008)

【XY】測定値 (0.006)

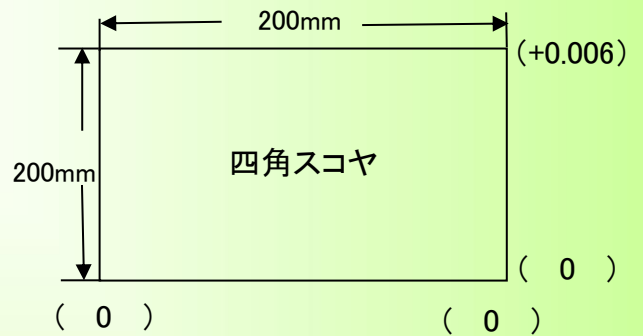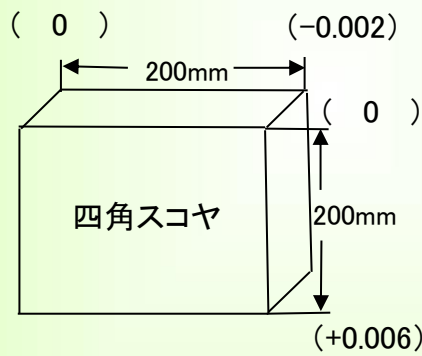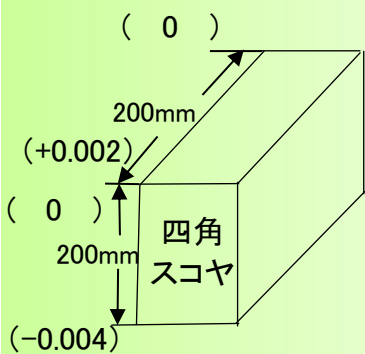

上面精度

※テーブルサイズ 650×400

