


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2006年製	管理番号	H015516
型式	VS10000/40/3150	測定者	平野	アシスタント	仙田

振り回し(300ピッチ)

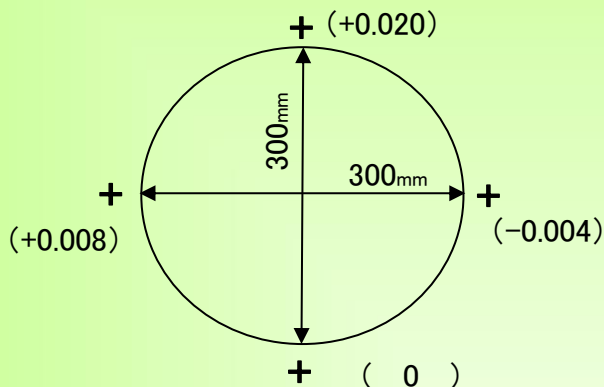

主軸振れ



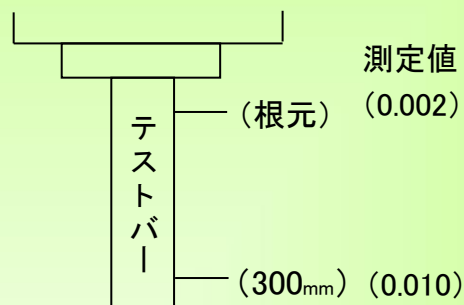


直角度

【YZ】測定値 (0.014)


【XZ】測定値 (0.026)

【X Y】測定値 (0.016)

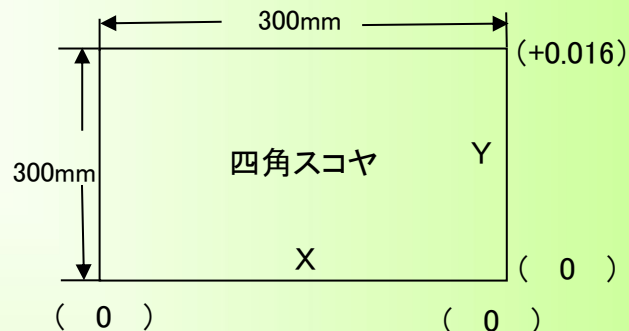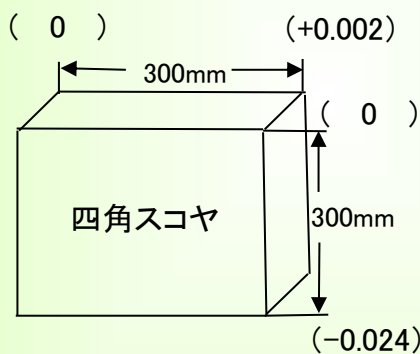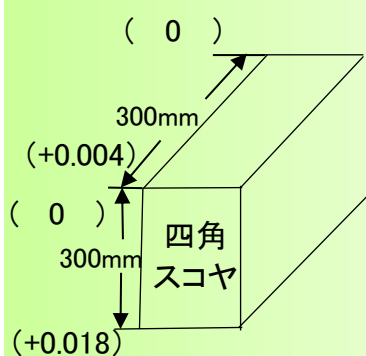

上面精度

※テーブルサイズ 3350 × 1000

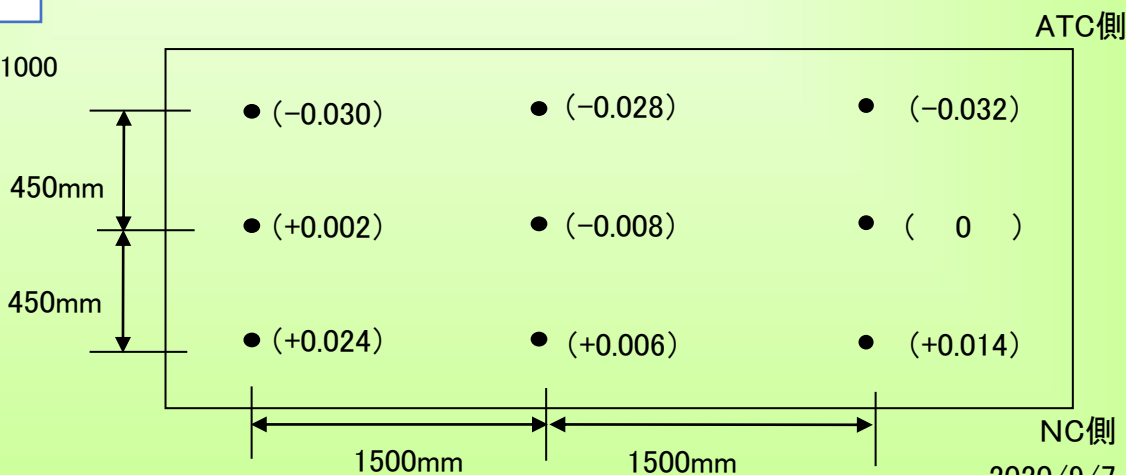

2020/9/7