


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	倉敷	年式	1994年製	管理番号	H015385
型式	CMN-6(L)	測定者	平野	アシスタント	仙田

振り回し(300ピッチ)

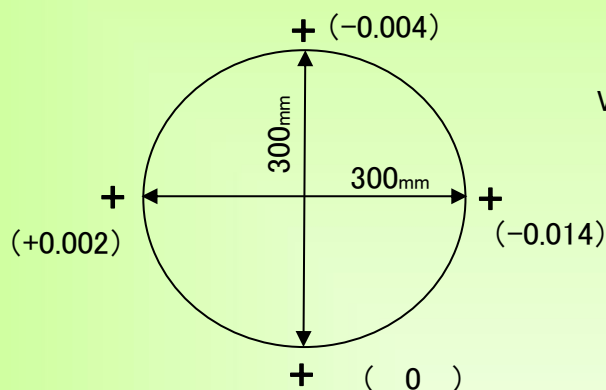

主軸振れ



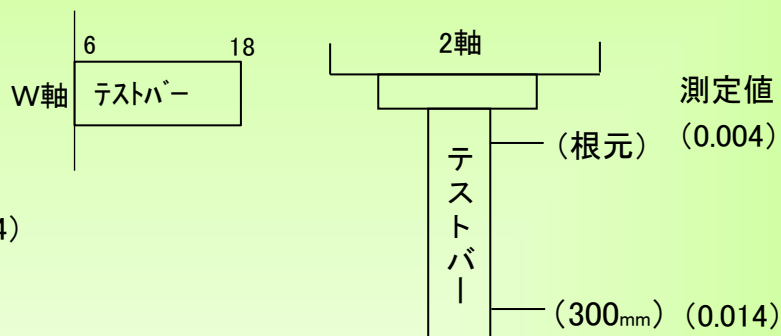


直角度

【YZ】測定値 (0.030)


【XZ】測定値 (0.004)

【X Y】測定値 (0.016)

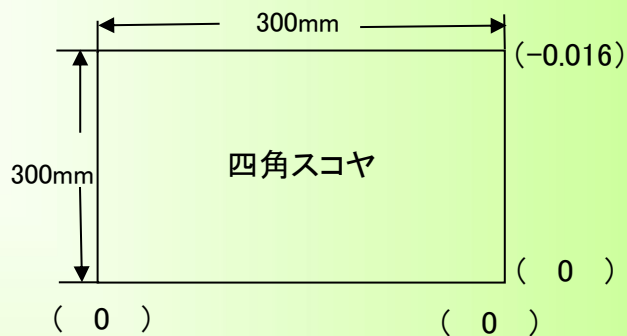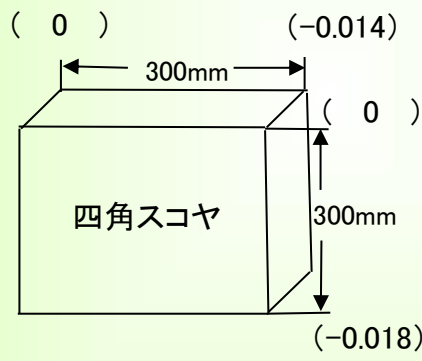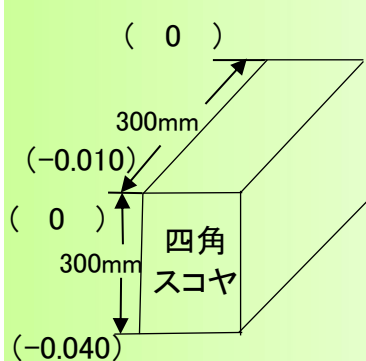

上面精度

※テーブルサイズ 2500 × 655

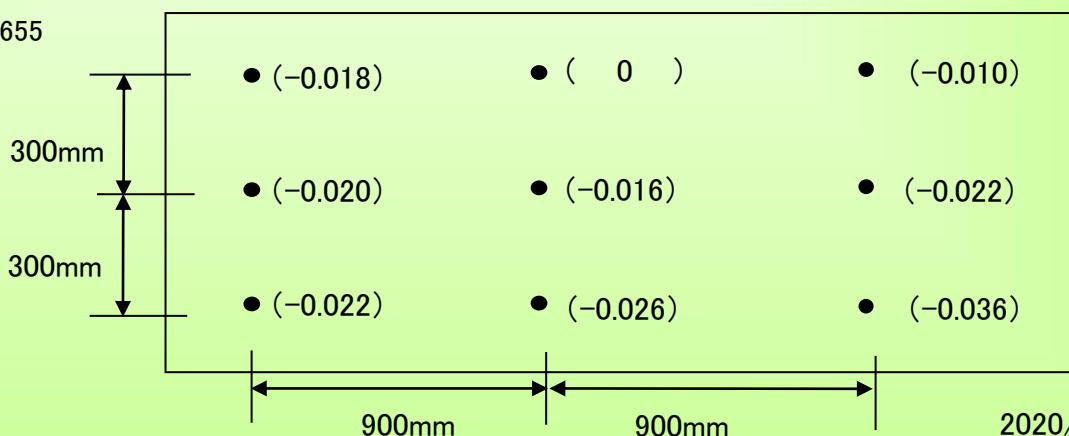

2020/9/8