



# 精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	安田	年式	2016年製	管理番号	H015544
型式	YBM-950V VERIII	測定者	平野	アシスタント	仙田

## 振り回し(300ピッチ)

## 主軸振れ

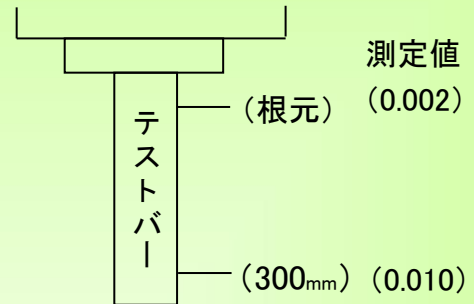
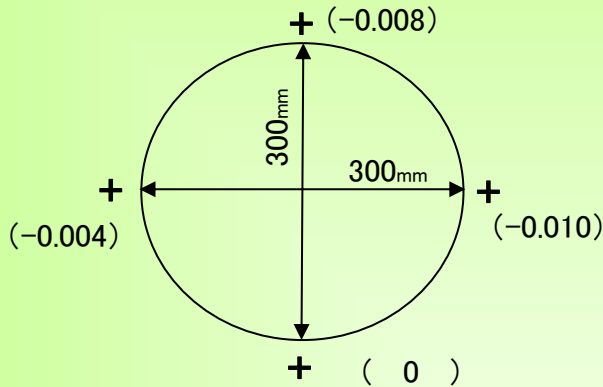


## 直角度

【YZ】測定値 (0.002)


【XZ】測定値 (0.004)

【XY】測定値 (0.004)

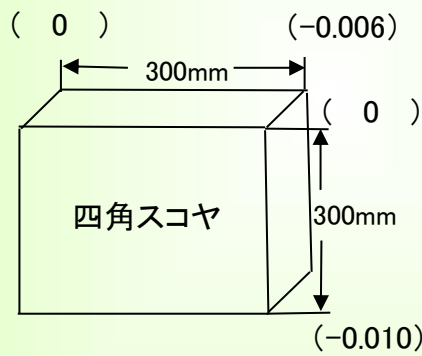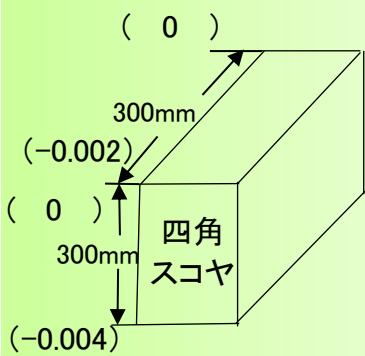

## 上面精度

※テーブルサイズ 1000×500

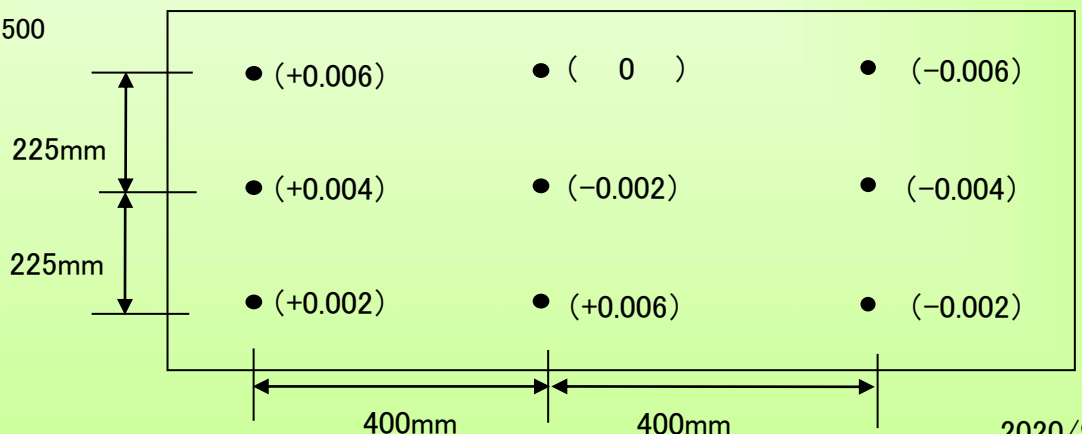

2020/9/11