



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	2007年製	管理番号	H015552
型式	VM900	測定者	仙田	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ

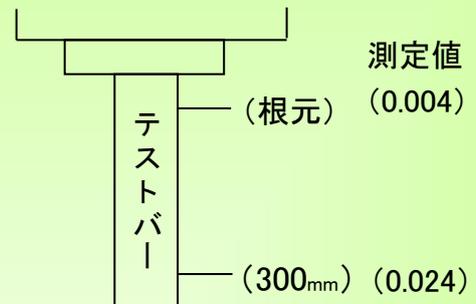
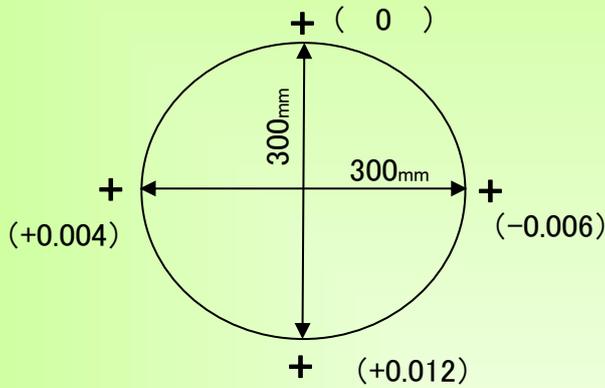


直角度

【YZ】測定値 (0.008)


【XZ】測定値 (0.004)

【XY】測定値 (0.010)

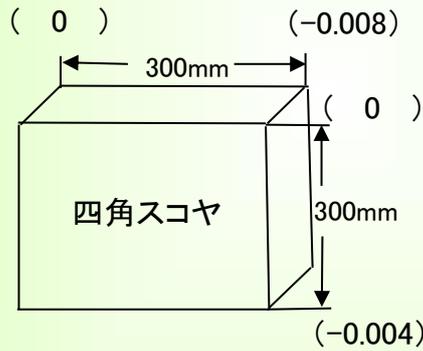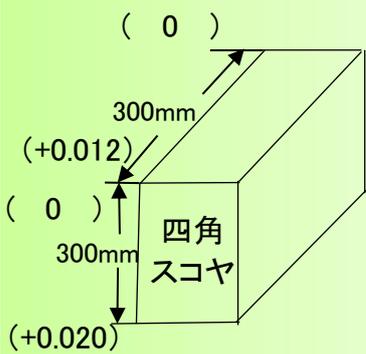

上面精度

※テーブルサイズ 2300×940

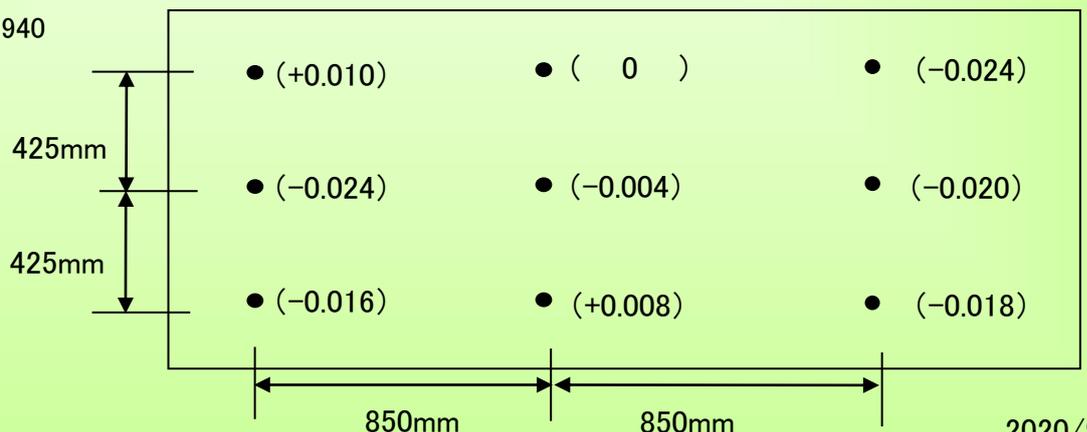

2020/9/18