



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2004年製	バーコード	P007230
型式	α -T21iDL	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ


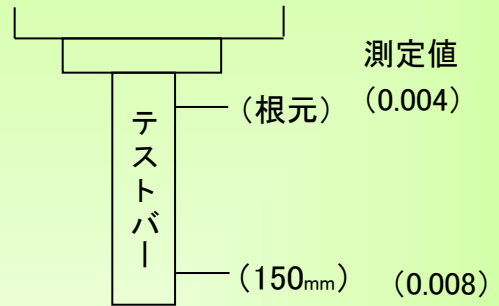
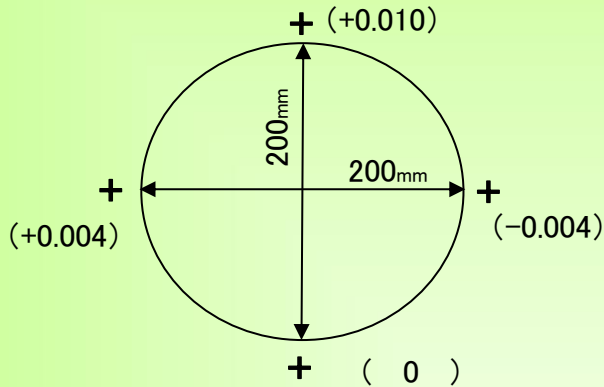


直角度

【YZ】測定値 (0.010)


【XZ】測定値 (0.008)

【XY】測定値 (0.008)

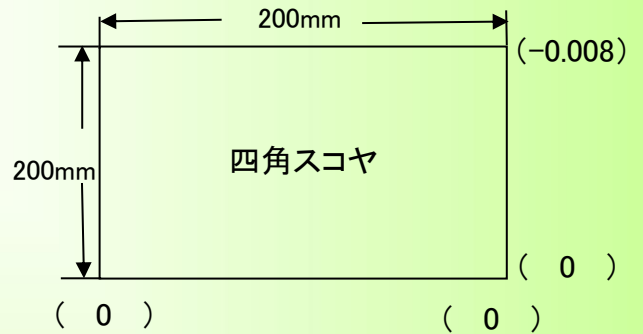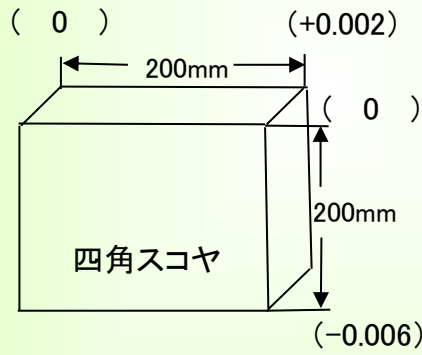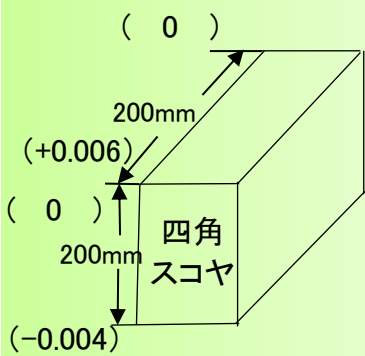

上面精度

※テーブルサイズ 850×410

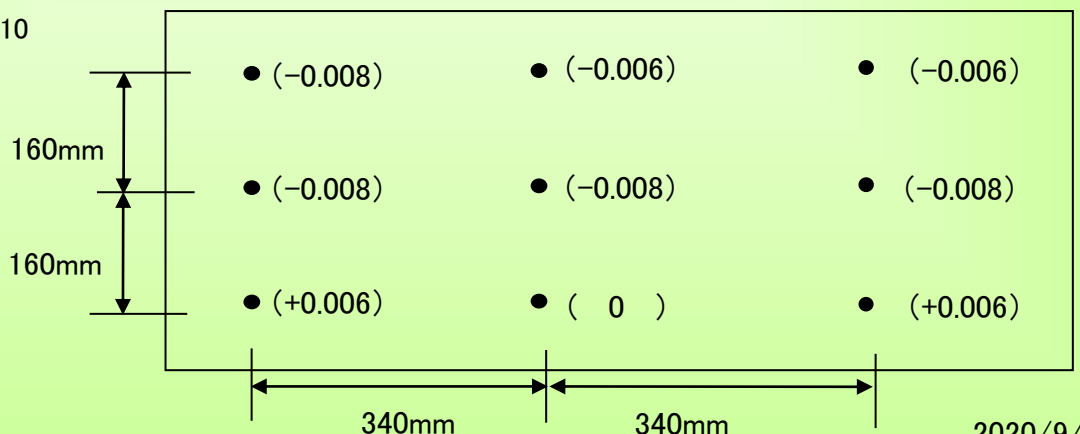

2020/9/18