



# 精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	森精機 (DMG MORI SEIKI)	年式	2012年製	バーコード	P006989
型式	MILLTAP700	測定者	奥澤	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

## 主軸振れ

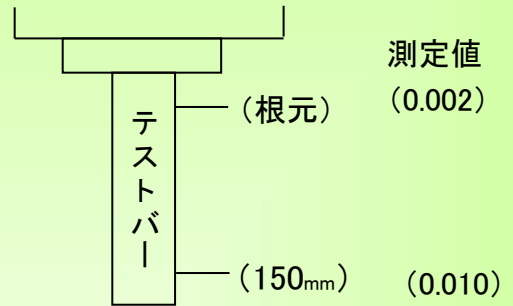
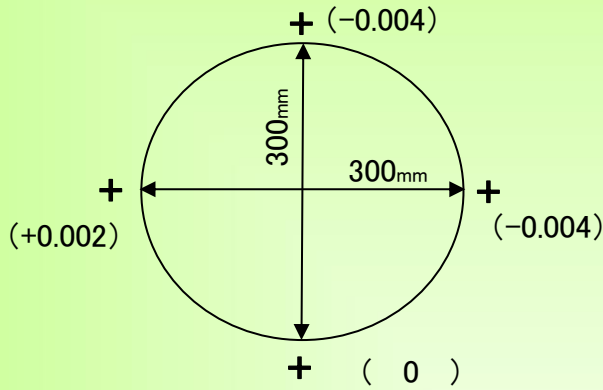


## 直角度

【YZ】測定値 (0.014)


【XZ】測定値 (0.018)

【XY】測定値 (0.008)

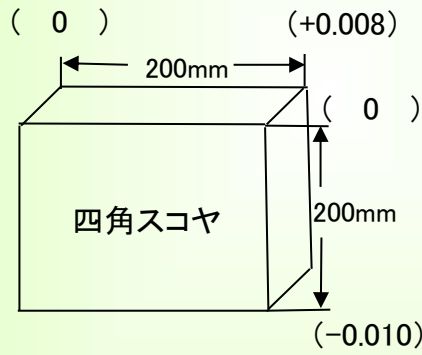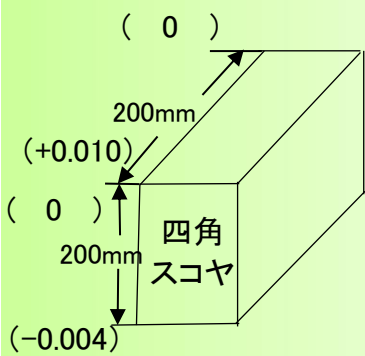

## 上面精度

※テーブルサイズ 840×420

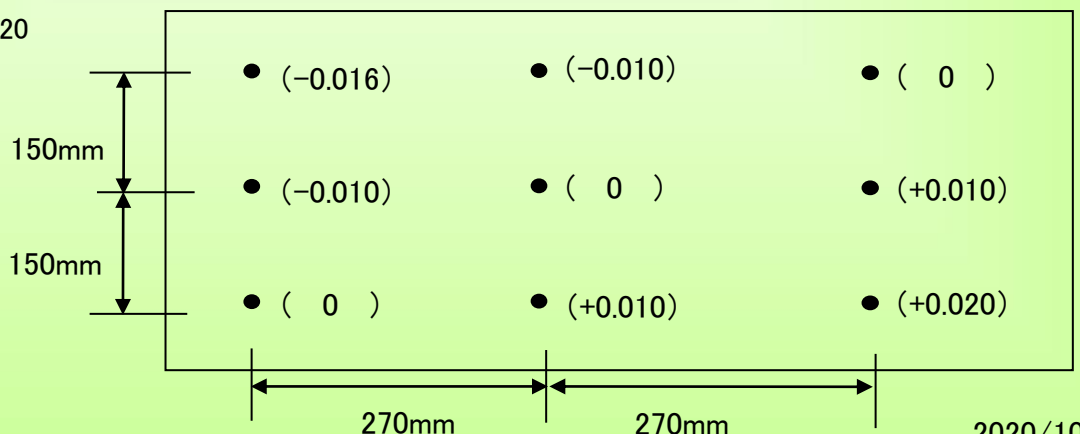

2020/10/5