



# 精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	2004年製	管理番号	P007238
型式	MILLAC-44V	測定者	金子	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

## 主軸振れ

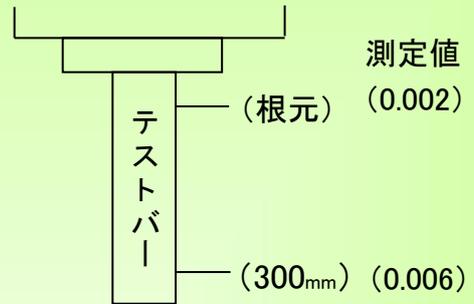
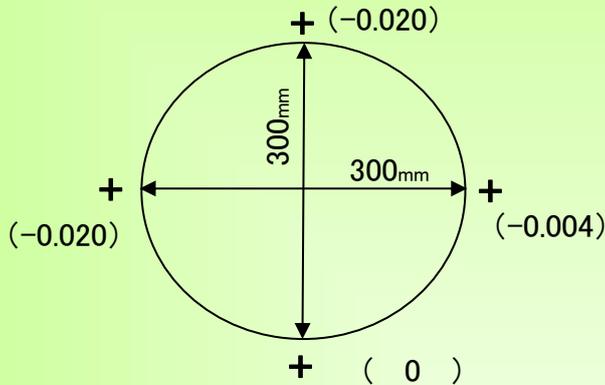


## 直角度

【YZ】測定値 (0.010)


【XZ】測定値 (0.010)

【XY】測定値 (0.002)

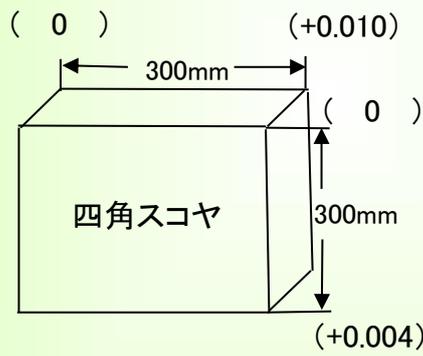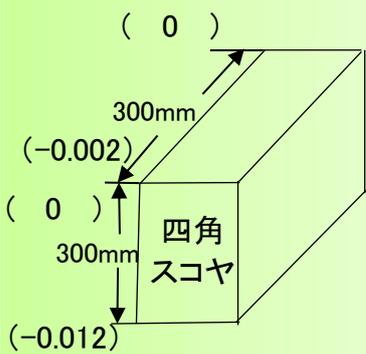

## 上面精度

※テーブルサイズ 630 × 400

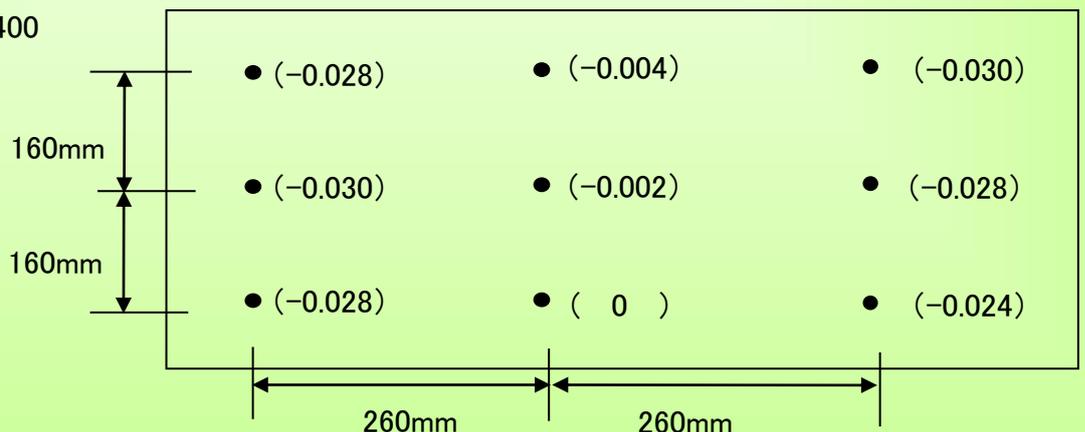

2020/10/10(気温16°C)