


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	豊田	年式	2005年製	バーコード	P007105
型式	GE4P-50	測定者	小林将	アシスタント	


主軸とZ軸の平行度

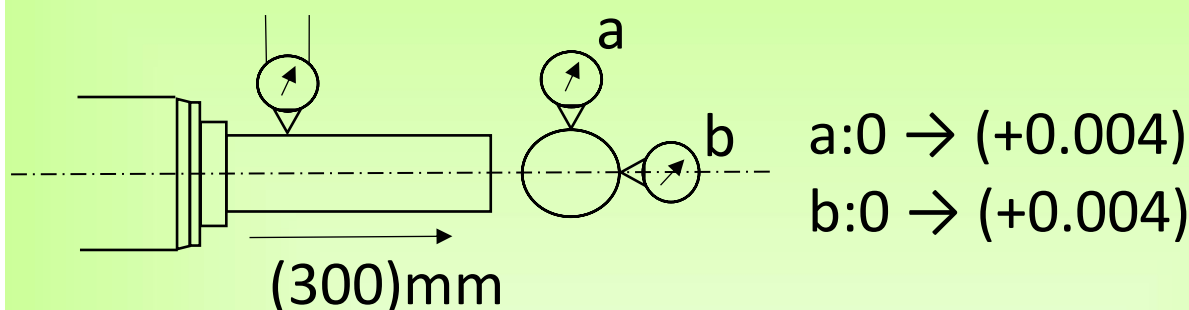


心押しとZ軸の平行度

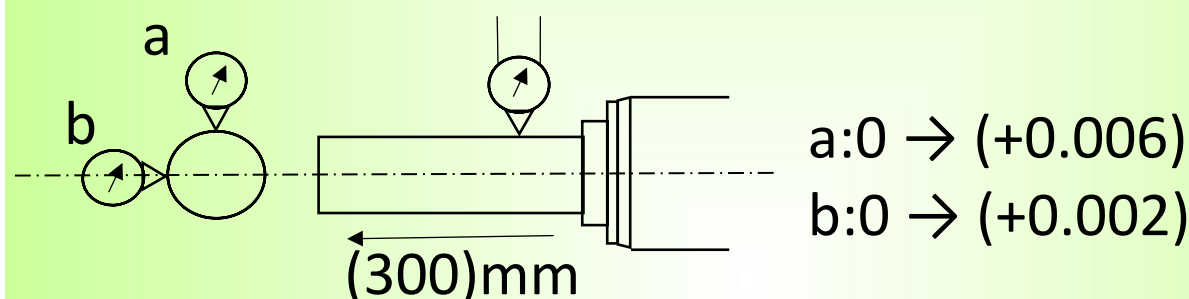

主軸と心押し間のZ軸の平行度

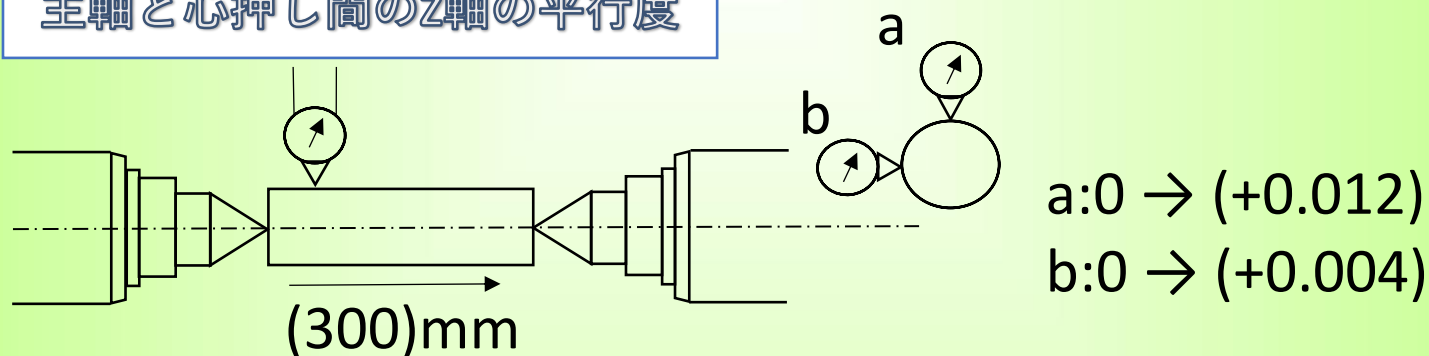

テスト加工

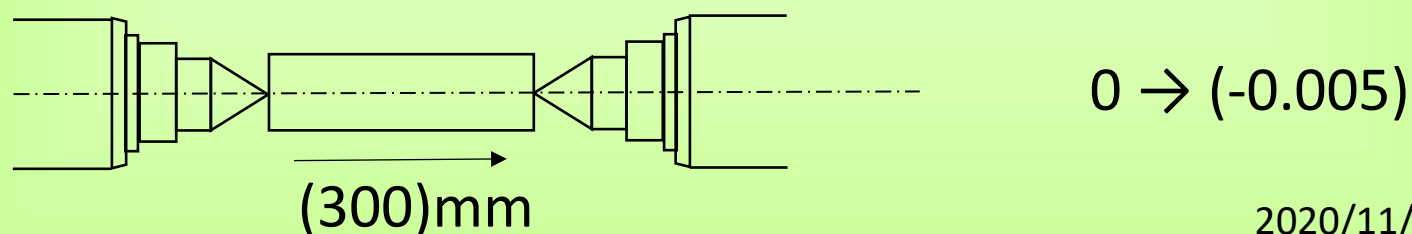

2020/11/2