



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	ブラザー	年式	2004年製	バーコード	P006876
型式	TC-S2B-0	測定者		アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

主轴振れ

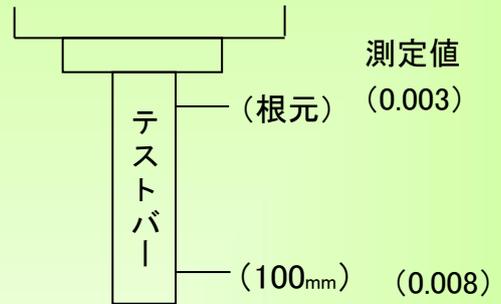
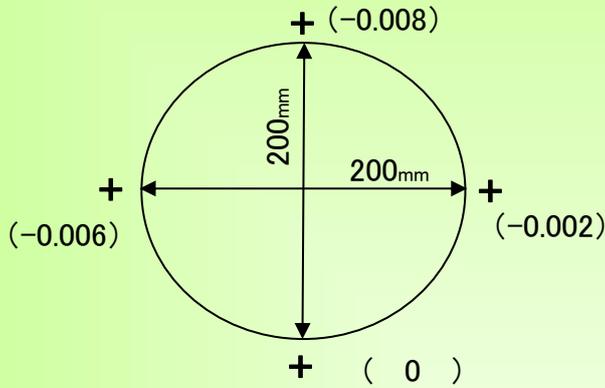


直角度

【YZ】 測定値 (0.020)

【XZ】 測定値 (0.008)

【XY】 測定値 (0.006)

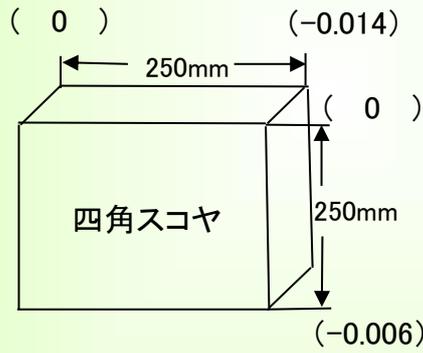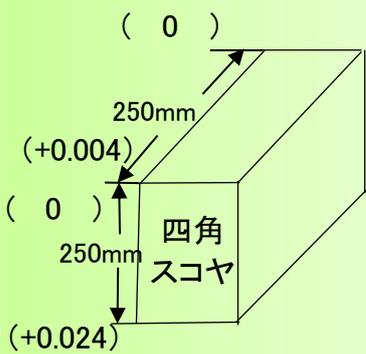


上面精度

BL X0.004 Y0.002 Z0.002

※テーブルサイズ 800×320

・XY軸少し異音有り

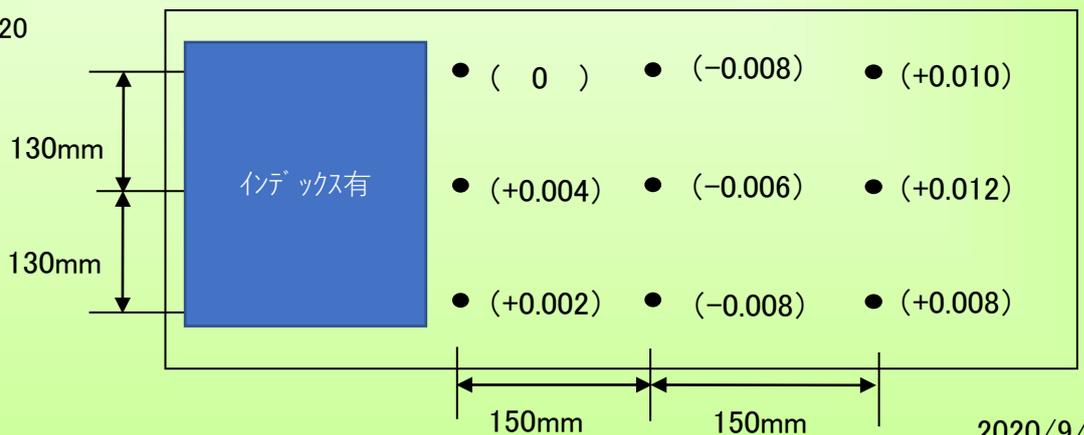

2020/9/30