



# 精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2004年製	管理番号	H015694
型式	$\alpha$ -T14iDS	測定者	武藤	アシスタント	

## 振り回し(200ピッチ)

## 主軸振れ


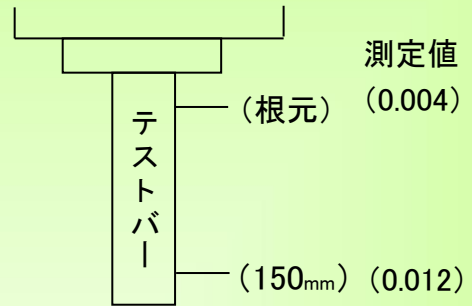
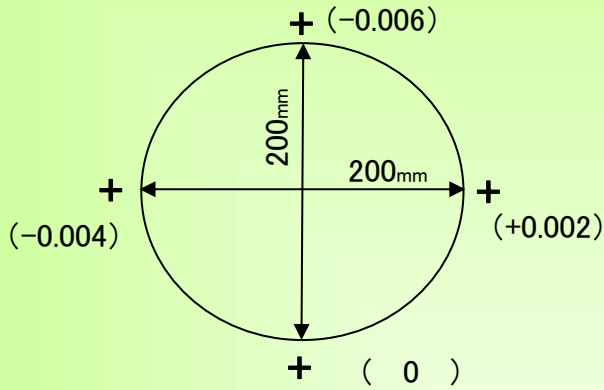


## 直角度

【YZ】測定値 (0.012)


【XZ】測定値 (0.006)

【XY】測定値 (0.020)

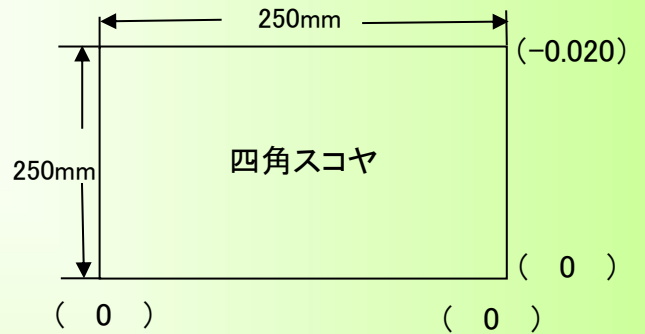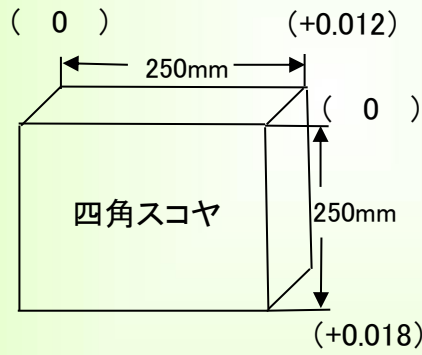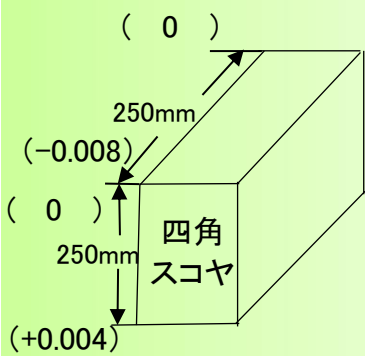

## 上面精度

※テーブルサイズ 630×330

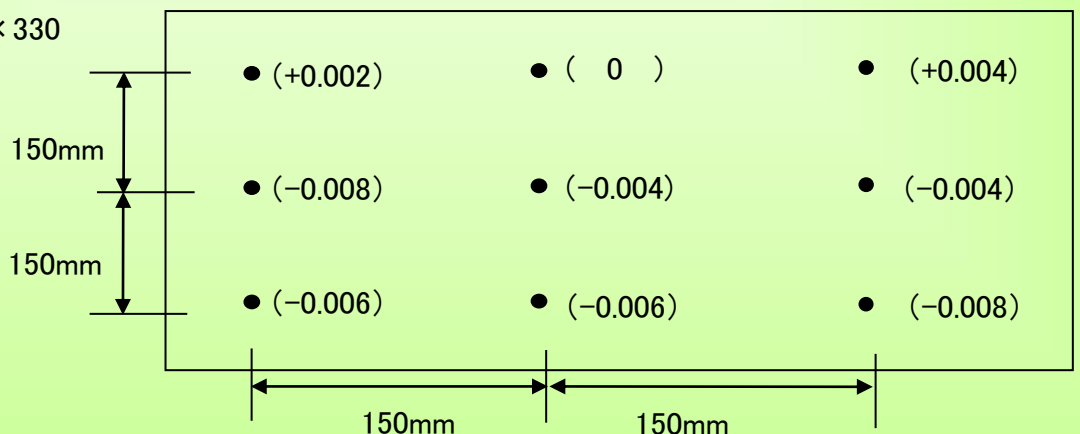

2020/11/06