精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	1995年製	管理番号	H015750
型式	MH-2V	測定者	山口	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

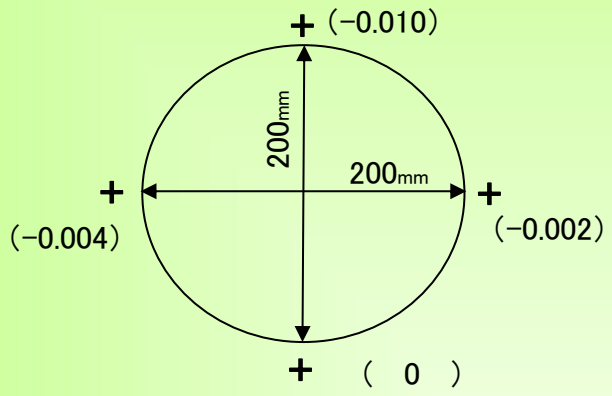

主軸振れ

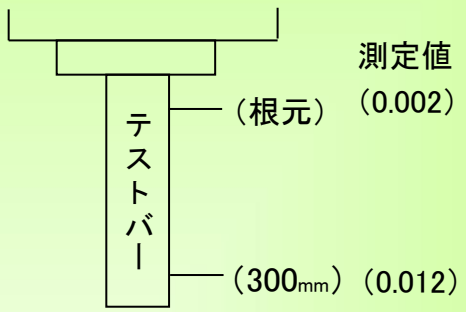

直角度

【YZ】測定値 (0.030)

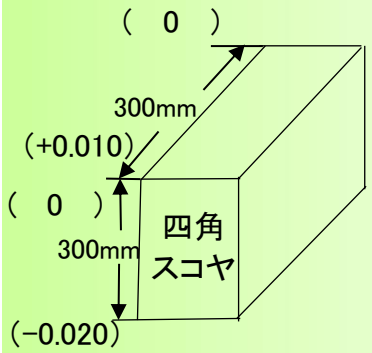

【XZ】測定値 (0.022)

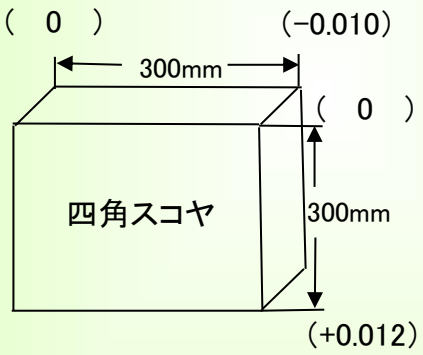

【X Y】測定値 (0.030)

上面精度

※テーブルサイズ 1310×300

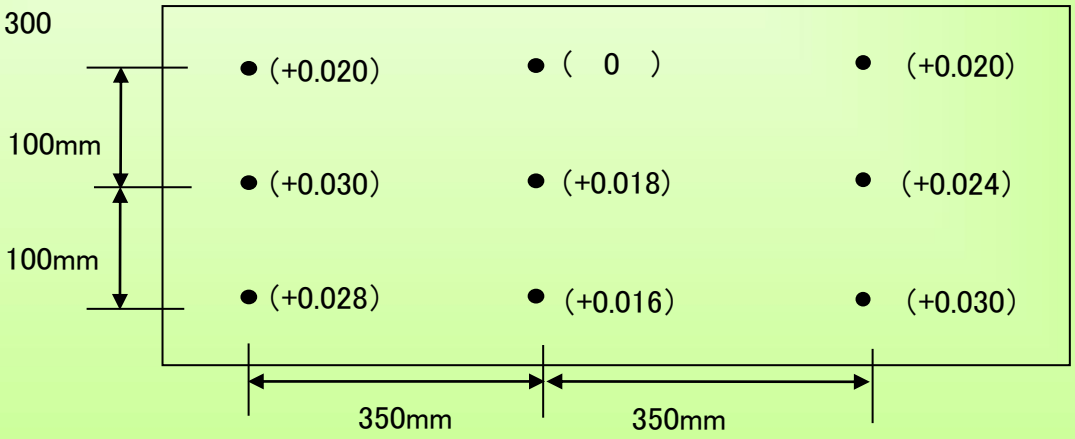

2020/11/20