

# 精度測定検査表



Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	2002年製	管理番号	P007305
型式	MILLAC-415V	測定者	金子	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

## 主軸振れ

気温10°C


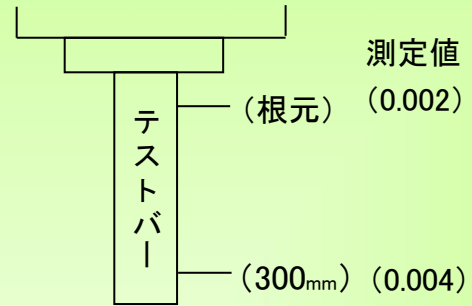
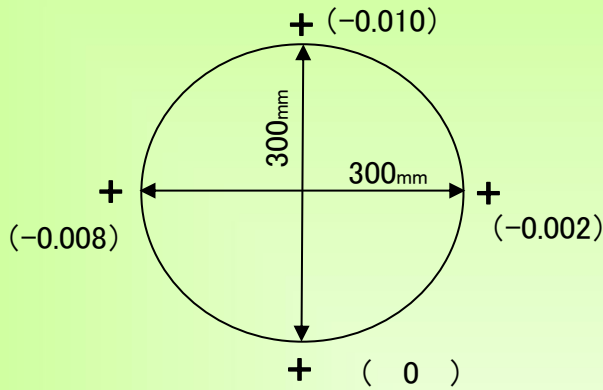


## 直角度

【YZ】測定値 (0.010)


【XZ】測定値 (0.008)

【XY】測定値 (0.012)

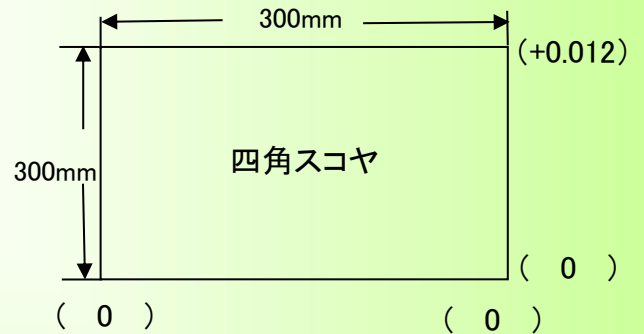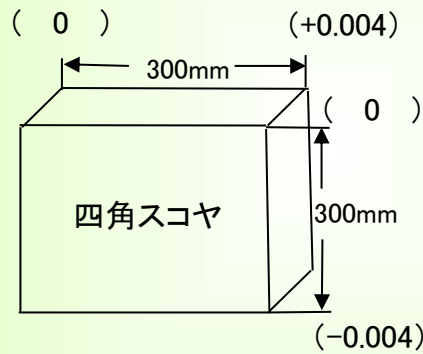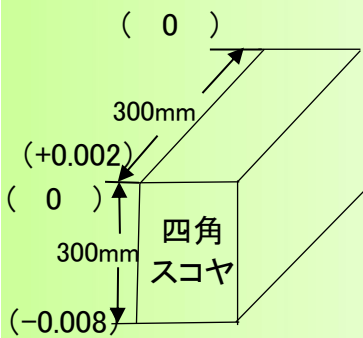

## 上面精度

※テーブルサイズ 700×400

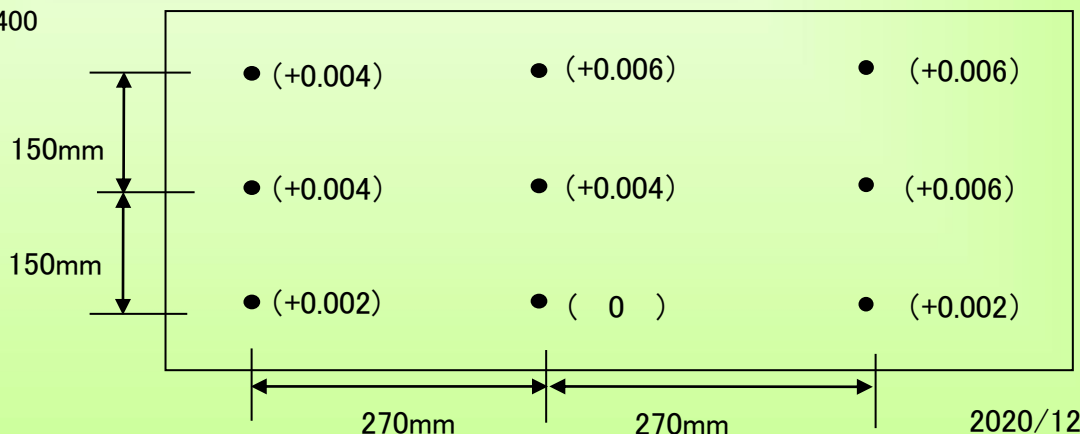

2020/12/4