



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	三井精機	年式	2007年製	管理番号	P007179
型式	VTX55X	測定者	奥沢	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ


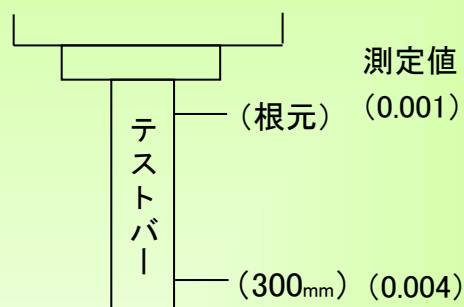
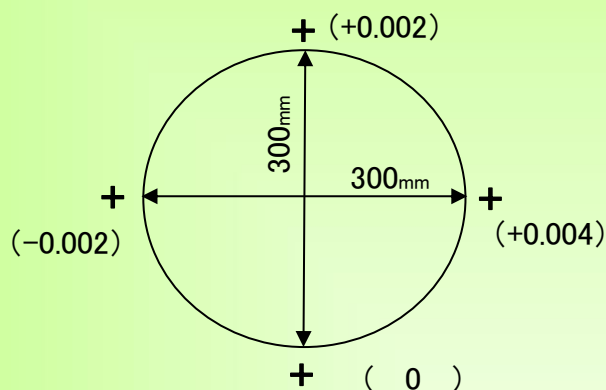


直角度

【YZ】測定値 (0.006)


【XZ】測定値 (0.008)

【X Y】測定値 (0.002)

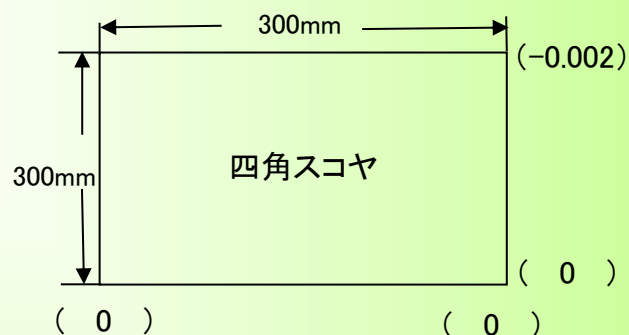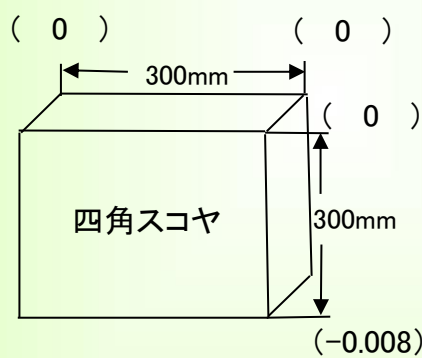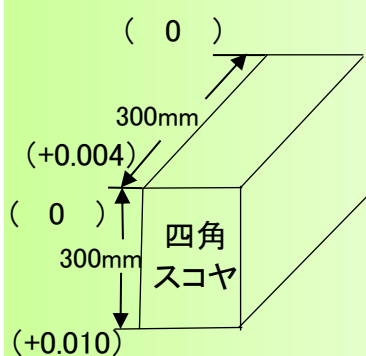

上面精度

※テーブルサイズ $\phi 400$

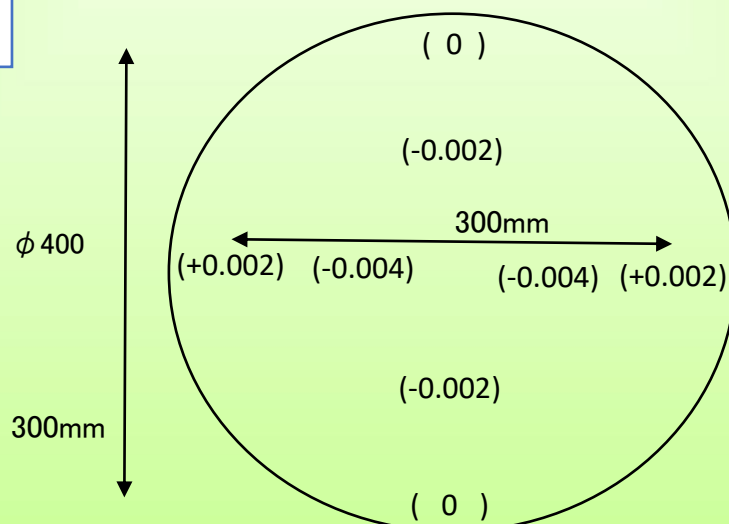

2020/11/27

EAST JAPAN MACHINE PLAZA