



精度測定検査表

Examination for precision list

| | | | | | |
|------|-----------|-----|--------|--------|---------|
| メーカー | 牧野フライス製作所 | 年式 | 2003年製 | 管理番号 | H015772 |
| 型式 | AVNC-74 | 測定者 | 尾内 | アシスタント | |

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ


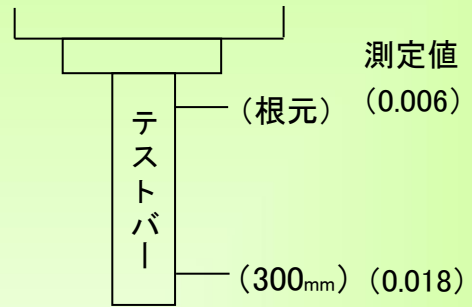
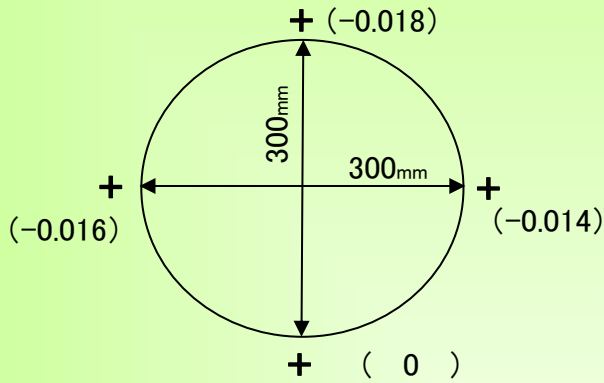


直角度

【YZ】測定値 (0.002)


【XZ】測定値 (0.028)

【XY】測定値 (0.012)

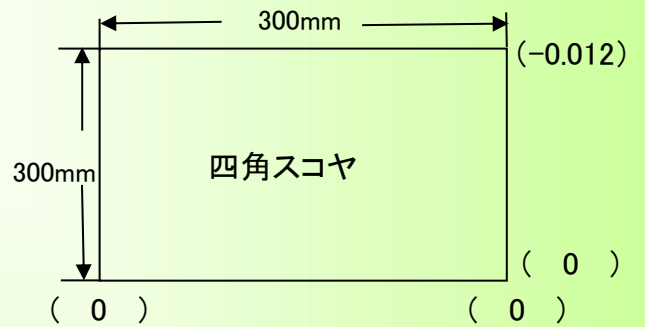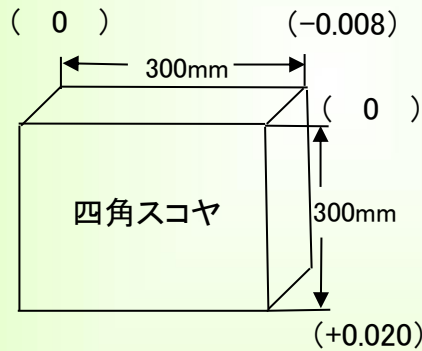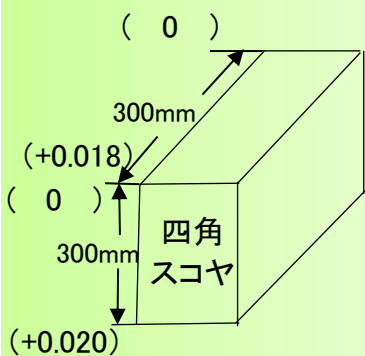

上面精度

※テーブルサイズ 1050×400

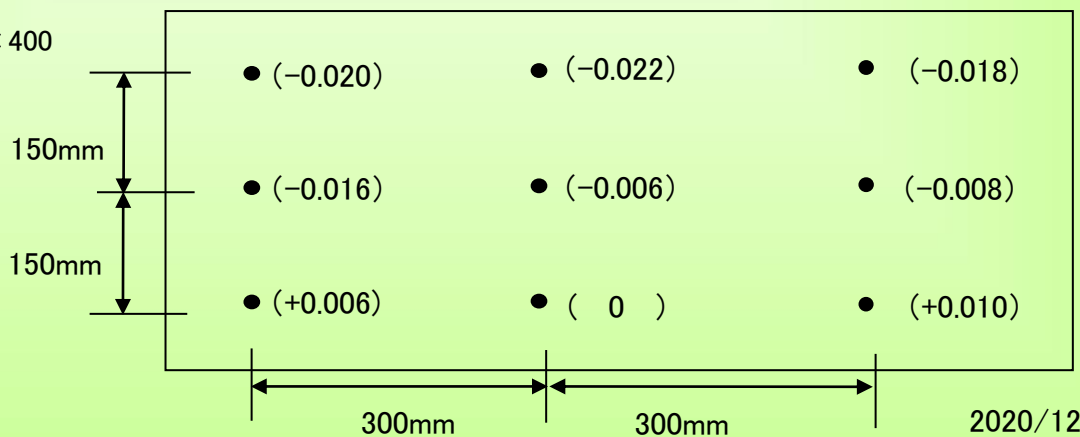

2020/12/8