



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2007年製	管理番号	P007267
型式	NV5000 α 1A/40	測定者	奥澤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ


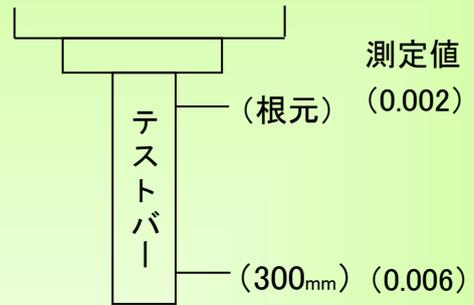
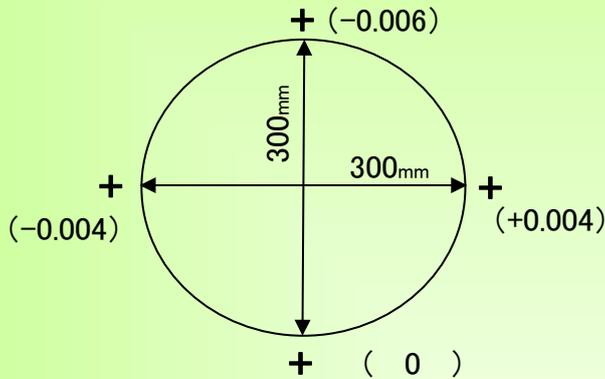


直角度

【YZ】測定値 (0.008)


【XZ】測定値 (0.016)

【XY】測定値 (0.008)

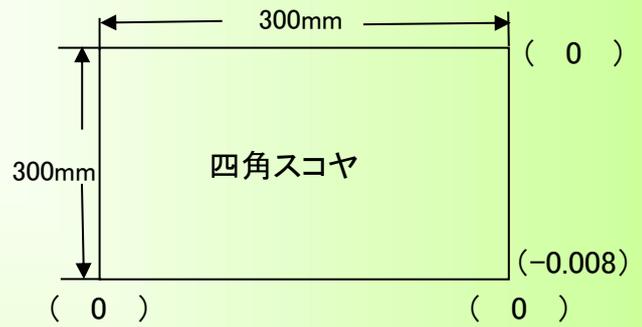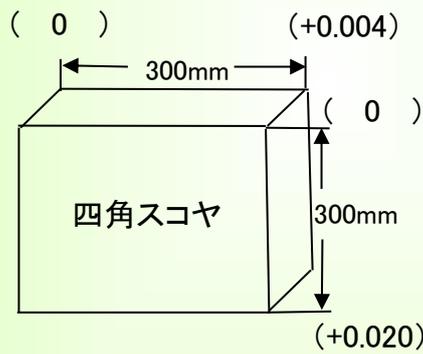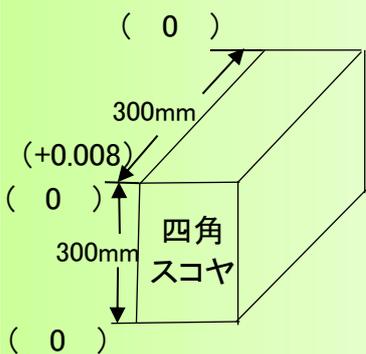

上面精度

※テーブルサイズ 1100×600

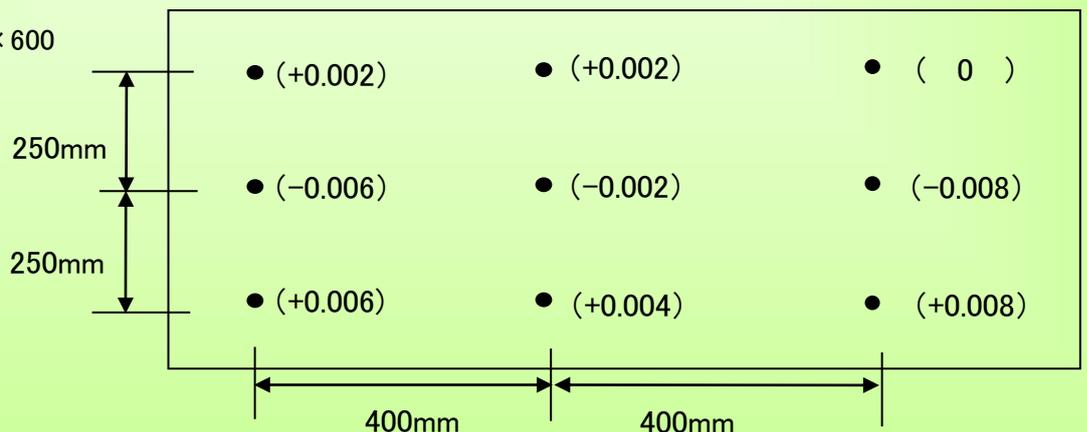

2020/12/12