



精度測定検査表

Examination for precision list

| | | | | | |
|------|-------|-----|--------|--------|---------|
| メーカー | OKK | 年式 | 1998年製 | 管理番号 | H015751 |
| 型式 | MH-2V | 測定者 | 山口 | アシスタント | |

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ

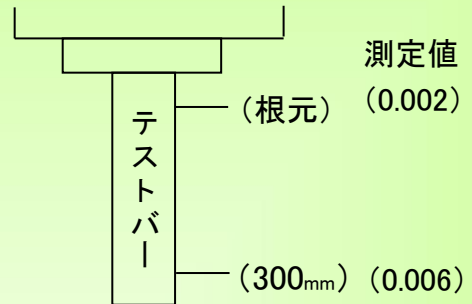
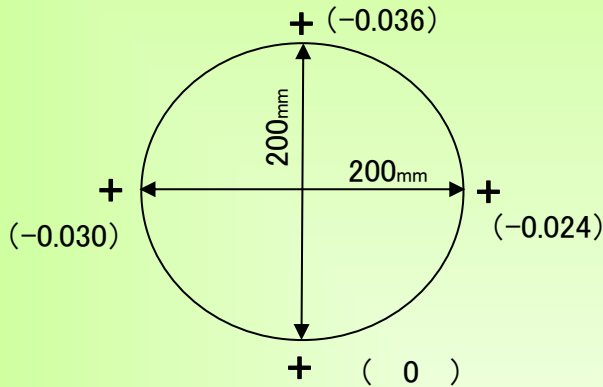


直角度

【YZ】測定値 (0.008)


【XZ】測定値 (0.014)

【XY】測定値 (0.014)

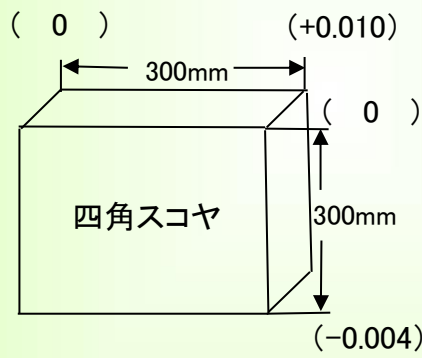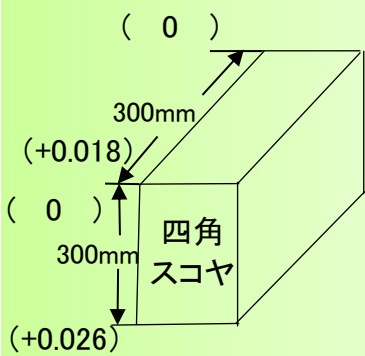

上面精度

※テーブルサイズ 1310 × 300

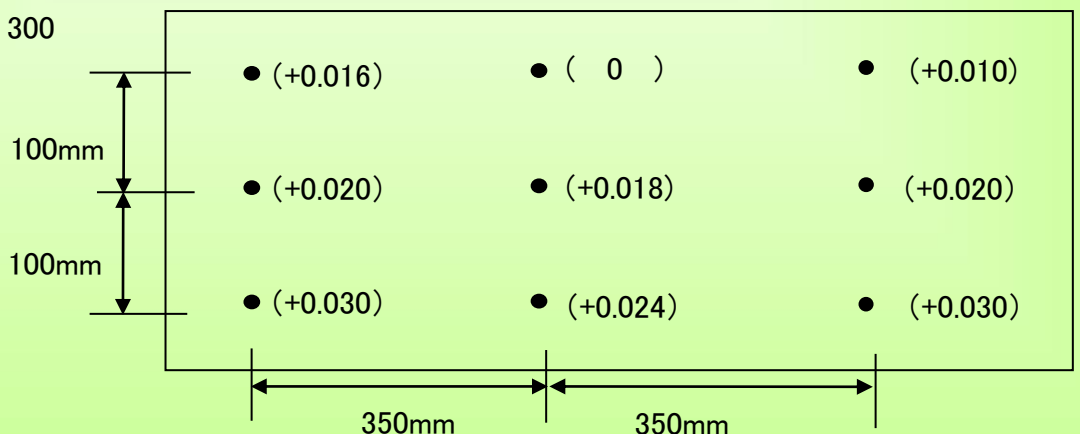

2021/1/7