



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	1998年製	管理番号	H014832
型式	MC-60VAE	測定者	仙田	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ


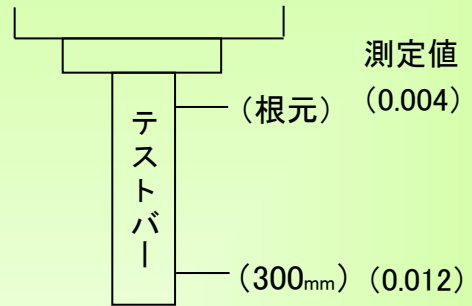
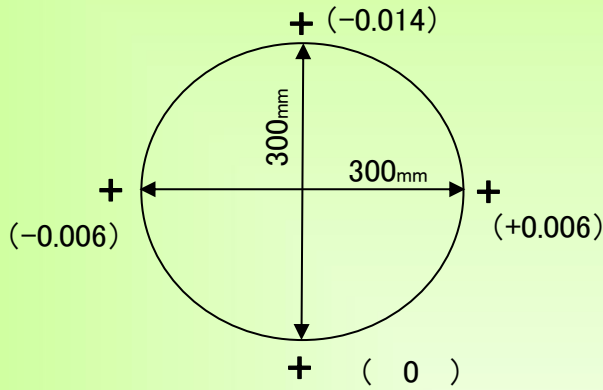


直角度

【YZ】測定値 (0.014)

【XZ】測定値 (0.014)


【XY】測定値 (0.010)

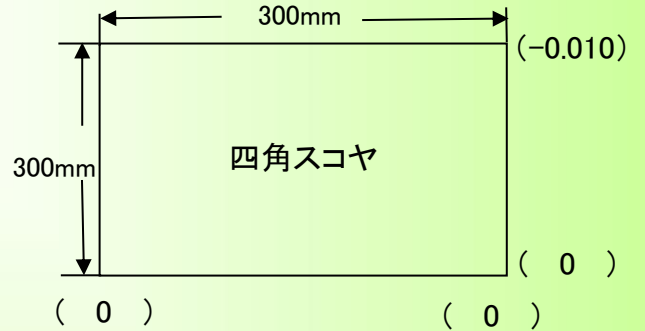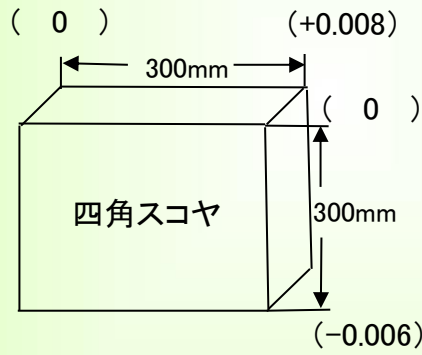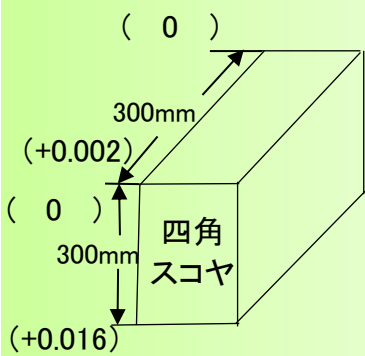

上面精度

※サブテーブル上面の為、参考値

※テーブルサイズ 1530 × 630

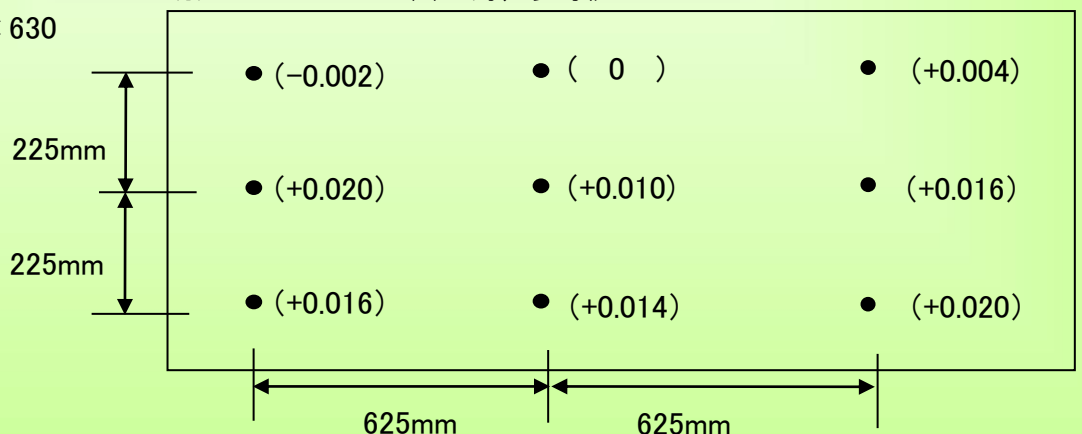

2021/1/18