


# 精度測定検査表


*Examination for precision list*

メーカー	ファナック	年式	2003年製	管理番号	P007325
型式	$\alpha$ -T14iDL	測定者	野辺沼	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

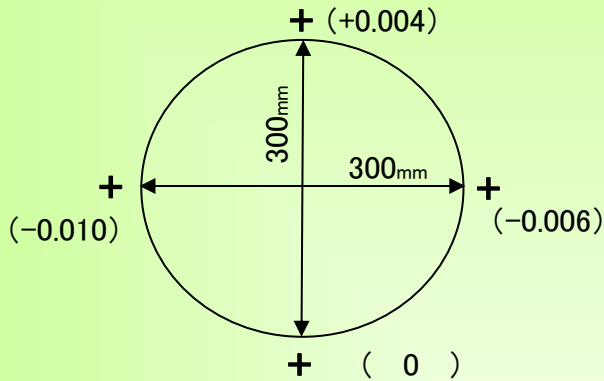

## 主軸振れ



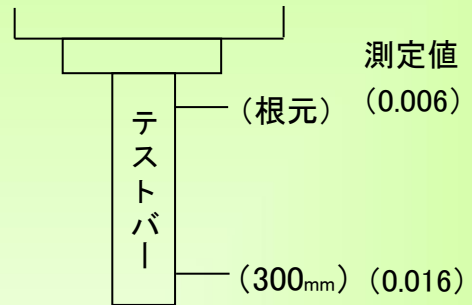


## 直角度

【YZ】測定値 (0.012)


【XZ】測定値 (0.014)

【XY】測定値 (0.004)

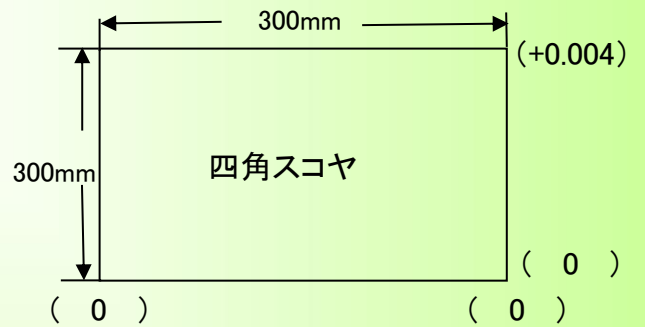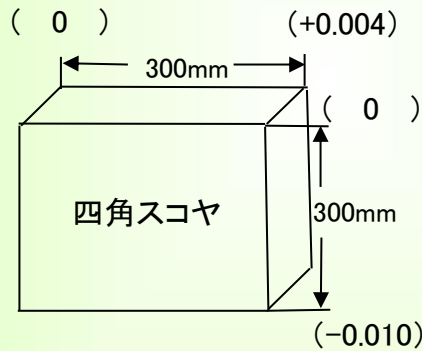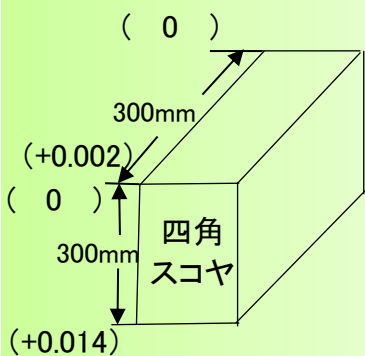

## 上面精度

※テーブルサイズ 850×410

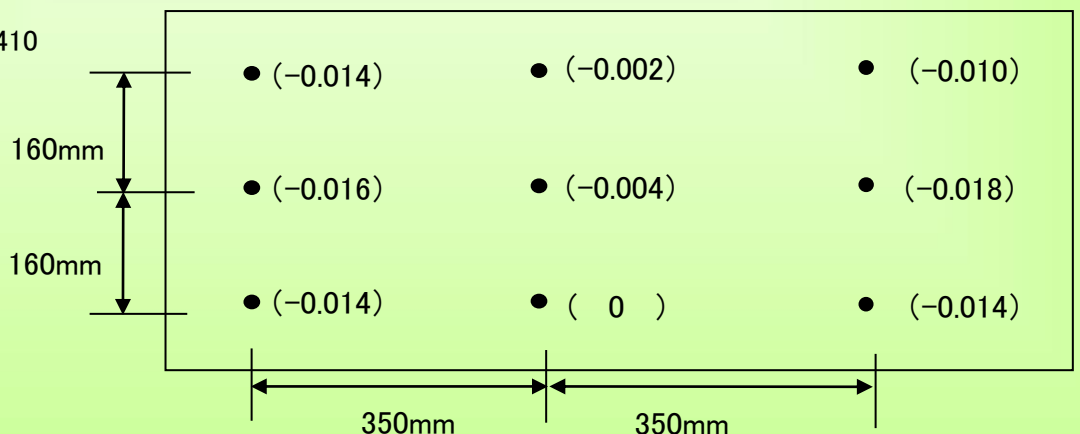

2021/1/28