


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2003年製	管理番号	P007339
型式	α-T14iD	測定者	金子	アシスタント	

## 振り回し(200ピッチ)

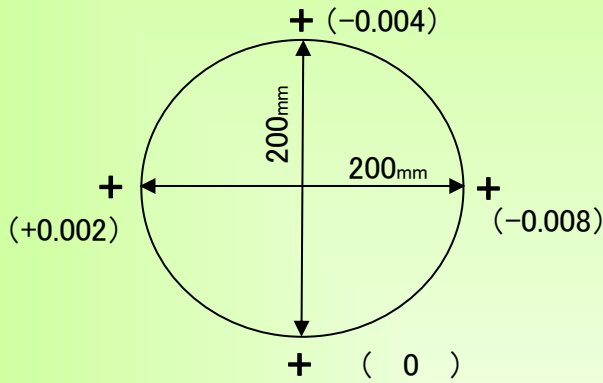

## 主軸振れ



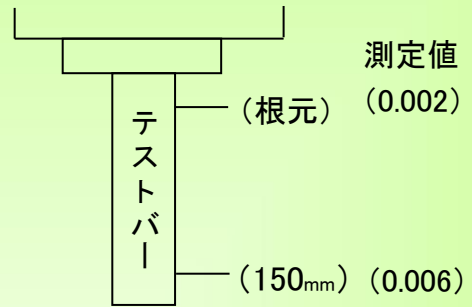


## 直角度

【YZ】 測定値 (0.004)


【XZ】 測定値 (0.010)

【XY】 測定値 (0.004)

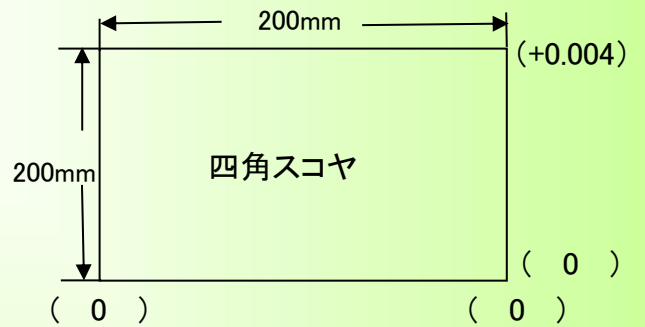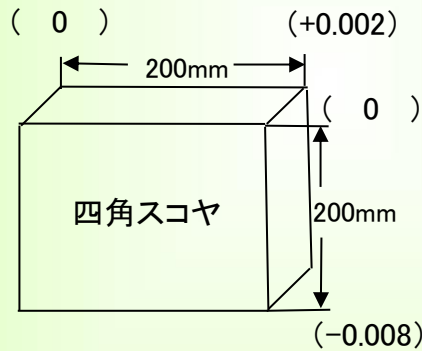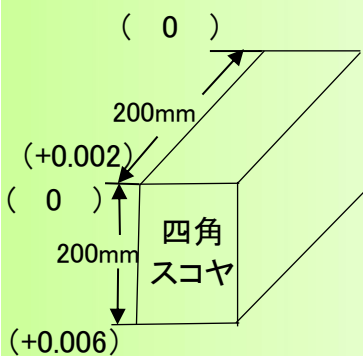

## 上面精度

※テーブルサイズ 650×400

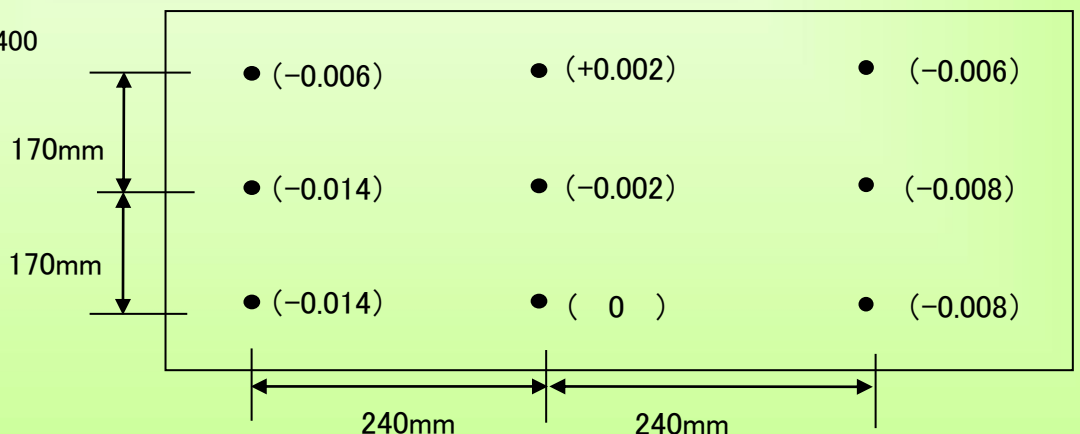

2021/2/1