


精度測定検査表

Examination for precision list


メーカー	OKK	年式	2005年製	管理番号	P007350
型式	VM7III	測定者	前田	アシスタント	野辺沼

プルスタッド MAS90°

振り回し(300ピッチ)

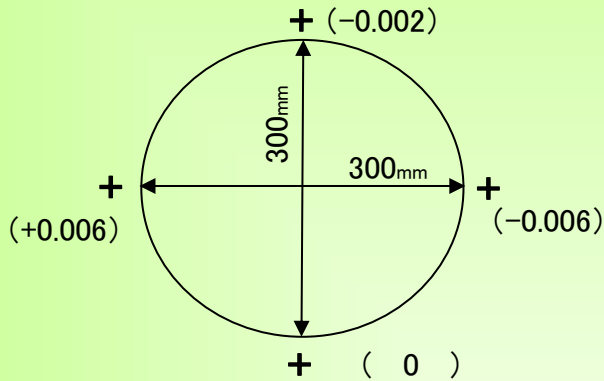

主軸振れ



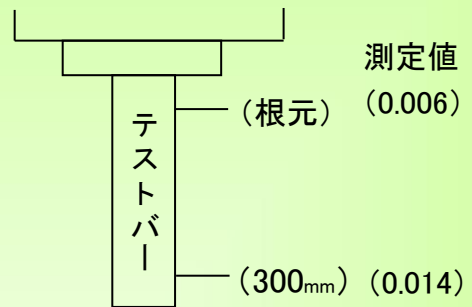


直角度

【YZ】測定値 (0.008)

【XZ】測定値 (0.010)

【XY】測定値 (0.016)

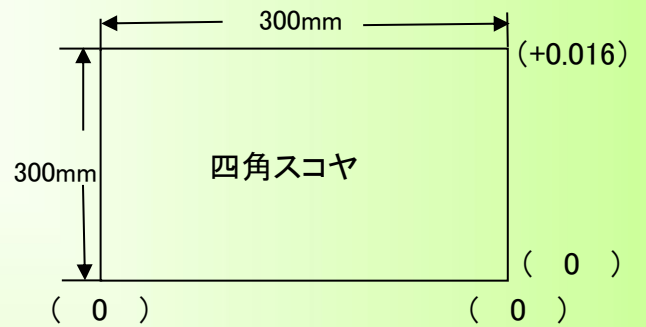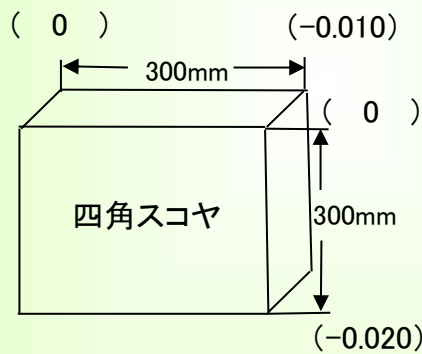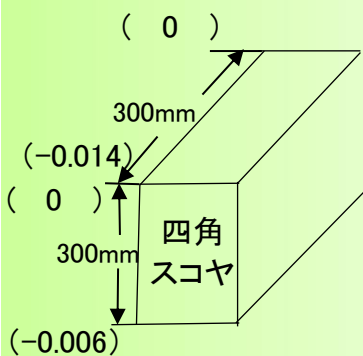

上面精度

※テーブルサイズ 1550×740

